



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/ 807/2025

Jelenia Góra 30.04.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych dla Oddziału Onkologicznego, Bloku Operacyjnego, Pracowni Leku Cytostatycznego, a także kaniul dożylnych bezpiecznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/07/02/2025**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do postępowania jak w tytule, które wpłynęły do Zamawiającego. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1 do pakietu 4 pozycja 2.13

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści również igły z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu? Oznakowanie kolorystyczne na opakowaniu igieł jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne rozróżnienie igieł o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Dzięki temu personel medyczny może łatwiej i szybciej dobrać odpowiednią igłę do procedury medycznej, co zmniejsza ryzyko pomyłek, poprawia efektywność pracy oraz zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 2 do pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści porty o parametrach jak poniżej:

Port infuzyjny	
Port wszczepialny	Tak
Port wysokoprofilowy wymiary:	standardowy
Podstawa: 35-40 mm x 20-25 mm	podstawa okrągła, średnica podstawy 26,7mm- parametr lepszy stożkowy kształt o okrągłej podstawie, nie wywołuje perforacji skóry
Wysokość portu: 11,5-12,5 mm	Tak
Średnica membrany: minimum 12 mm	Tak



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia)	Tak
Parametry cewnika:	
Cewnik 7-8F	Tak
Długość całkowita: minimum 60 cm	Tak
Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna	Tak
Cewnik skalowany co 1 cm	Tak
Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm	Tak
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne	Tak, obudowa wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego
Materiał komory: tytan	tak, parametr równoważny komora wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego o mocy tytanu, wytrzymuje do 7 tesla
Materiał cewnika: silikon	Poliuretan
Materiał membrany: silikon	Tak
Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć	tak, spełniona norma wytrzymałościowa (ISO 10555-6 §4.5.3)zamawiający nie podał dla jakiej igły wytrzymałość, spełniamy normy i badania były wykonane w oparciu o igły dla igły 19/20G- ilość nakłuć 1000, dla igły 22G- 1500 nakłuć
Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym	Tak
Port kompatybilny z tomografem komputerowym	Tak
Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym	Tak
Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
Instrukcja obsługi do każdego portu	Tak
Książeczka pacjenta w języku polskim	Tak
Książeczka pacjenta do każdego portu	Tak

Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające przynajmniej informację: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu	Tak
Port w komplecie z zestawem wprowadzającym	Tak
Zestaw zawiera:	
Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt.	Tak
Igła Hubera 22G - 1 szt.	Tak
Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt.	Tak
Prowadnik "J" (0,035" - 60 cm) - 1 szt.	Prowadnik "J" (0,035" - 50 cm) - 1 szt.- nie zmienia leczenia
Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt.	Tak
Tunelizator, długość: 20-30 cm	Tak
Nasadka do płukania drenu - 1 szt.	Tak
Strzykawka 10 ml - 1 szt.	Tak
Możliwość podania przez port:	
Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków)	Tak
Krwi	Tak
Żywienia pozajelitowego+C3	Tak
Środków kontrastowych	Tak
Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm	Tak
Port infuzyjny	
Port wszczepialny	Tak
Port niskoprofilowy wymiary:	Tak
Podstawa: 19-21 mm x 24-26 mm	podstawa okrągła, średnica podstawy 26,7mm- parametr lepszy, j.w - wyjaśnienie w punkcie
Wysokość portu: 9,5 - 10,5 mm	Wysokość portu 12,1mm
Średnica membrany: minimum 12 mm	Tak

Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia)	Tak
Parametry cewnika:	Tak
Cewnik 6F - 7,5F	Cewnik 6F - 8F, nie zmienia leczenia, dopuszcza konkurencyjne produkty
Przynajmniej 2 różne grubości cewnika, jeden w zakresie 6-7F, drugi 7-7,5F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (np. 6,5 i 7F)	Przynajmniej 2 różne grubości cewnika, jeden w zakresie 6-7F, drugi 7-8F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy
Długość całkowita: minimum 60 cm	Tak
Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna	Tak
Cewnik skalowany co 1 cm	Tak
Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm	Tak
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne	Tak, obudowa wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego
Materiał komory: tytan	komora wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego wytrzymała do 7 Tesla , bardziej odporny materiał innowacyjny do tytanu , parametr lepszy
Materiał cewnika: silikon	Poliuretan
Materiał membrany: silikon	Tak
Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć	tak, spełniona norma wytrzymałościowa (ISO 10555-6 §4.5.3)zamawiający nie podał dla jakiej igły wytrzymałość, spełniamy normy i badania były wykonane w oparciu o igły dla igły 19/20G- ilość nakłuć 1000, dla igły 22G- 1500 nakłuć
Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym	Tak
Port kompatybilny z tomografem komputerowym	Tak
Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym	Tak
Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
Instrukcja obsługi do każdego portu	Tak
Książeczka pacjenta w języku polskim	Tak
Książeczka pacjenta do każdego portu	Tak

Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu	Tak
Port w komplecie z zestawem wprowadzającym	Tak
Zestaw zawiera:	
Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt.	tak, pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt.
Igła Hubera 22G - 1 szt.	Tak
Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt.	Tak
Prowadnik "J" (0,035" - 60 cm) - 1 szt.	Prowadnik "J" (0,035" - 50 cm) - 1 szt.
Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt.	Tak
Tunelizator, długość: 20-30 cm	Tak
Nasadka do płukania drenu - 1 szt.	Tak
Strzykawka 10 ml - 1 szt.	Tak
Możliwość podania przez port:	
Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków)	Tak
Krwi	Tak
Żywienia pozajelitowego	Tak
Środków kontrastowych	Tak
Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm, dla większej grubości cewnika	Tak
Wraz z portem jałowy rękaw na głowicę USG o długości minimum 100 cm oraz jałowy żel do USG	Tak, pakowany oddzielnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty jak w pytaniu w zakresie:

- Podstawa: podstawa okrągła, średnica podstawy 26,7mm- parametr lepszy stożkowy kształt o okrągłej podstawie, nie wywołuje perforacji skóry
- Wytrzymałość membrany: spełniona norma wytrzymałościowa (ISO 10555-6 §4.5.3)zamawiający nie podał dla jakiej igły wytrzymałość, spełniamy normy i badania były wykonane w oparciu o igły dla igły 19/20G- ilość nakłuć 1000, dla igły 22G- 1500 nakłuć
- Prowadnik "J" (0,035" - 50 cm) - 1 szt.- nie zmienia leczenia
- Podstawa: podstawa okrągła, średnica podstawy26,7mm- parametr lepszy, j. w - wyjaśnienie w punkcie
- Cewnik 6F - 8F, nie zmienia leczenia, dopuszcza konkurencyjne produkty
- Prowadnik "J" (0,035" - 50 cm) - 1 szt.
- Wraz z portem jałowy rękaw na głowicę USG o długości minimum 100 cm oraz jałowy żel do USG- Tak, pakowany oddzielnie

Zamawiający nie dopuszcza produktów jak w pytaniu w zakresie:

- Materiał komory: parametr równoważny komora wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego o mocy tytanu, wytrzymuje do 7 tesla
- Materiał cewnika: Poliuretan
- Wysokość portu: 12,1mm
- Materiał komory - komora wykonana z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego wytrzymała do 7 Tesla , bardziej odporny materiał innowacyjny do tytanu , parametr lepszy

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1 do pakietu Nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7 x 5 x 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2 do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw do pełnych godzin pracy apteki wobec dostaw wyrobów medycznych z pakietu numer 7?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 Ust. 6, 7:

6. W przypadku zwłoki z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z winy Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej **niż 50,00 zł brutto** dziennie, nie więcej jednak niż łącznie **10 %** wartości **niezrealizowanej w terminie części umowy netto**.
7. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy, ~~nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto~~. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1 do pakietu nr 4, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do portu naczyniowego ze szlifem Hubera dotychczas używanych w Państwa Szpitalu, spełniających warunki zawarte w opisie poza możliwością podawania środków kontrastujących pod wysokim ciśnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

ZESTAW NR 5

Pytanie Nr 1 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 1-7 kaniule bezpieczne dożylnie z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 2 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 1-7 kaniule bezpieczne dożylnie z 6 paskami RTG? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 1 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 33ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 4 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 2 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 55ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 3 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 85ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 4 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 85ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 5 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 140ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 6 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 200ml/min? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 7 kaniule bezpieczne dożylnie z przepływem 270ml/min o rozmiarze 14G (2,1X45MM) ? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1 do pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez możliwości podawania żywienia pozajelitowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 do pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Kaniuła dożylna typu bezpiecznego, igła kaniuli zaopatrzona jest w specjalny automatyczny metalowy zatrząsk zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, kaniuła zabezpieczona plastikową nasadką na igłę, materiał cewnika PTFE, kaniuła z portem bocznym, wyposażona w 4 paski kontrastujące w RTG, przezroczysta komora zwrotna ułatwiająca wizualizację krwi, bez lateksu i ftalanów, bez PVC, opakowanie jednostkowe typu blister-pack (papierfolia), rozmiary:

22G 0,9x25mm - przepływ 36 ml/min

20G 1,1x33mm - przepływ 61 ml/min

18G 1,3x45mm - przepływ 90 ml/min

17G 1,5x45mm - przepływ 140 ml/min

16G 1,8x45mm - przepływ 200 ml/min

14G 2,1x45mm - przepływ 300 ml/min?

Reszta parametrów zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści filtr długości ok. 21cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera z drenem, podstawę igły z TPU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści skrzydełka z TPU oraz rozmiary 20G x 19mm, 20G x 25mm, 22G x 19 oraz 22G x 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „kompatybilny ze środowiskiem rezonansu magnetycznego”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW NR 8

Pytanie Nr 1 dot. pakietu Nr 1, poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 „*Filtry infuzyjne i strzykawkowe*”, w pozycji 1.8 dopuści wyrób o długość od złącza luer-lock do złącza luer lock – do 32 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 2 dot. pakietu Nr 8, poz.1

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, o przepływie 36 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 3 dot. pakietu Nr 8, poz.2

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, w rozmiarze 20G (1,1x33mm) o przepływie 67 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 4 dot. pakietu Nr 8, poz.3

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, w rozmiarze 18G (1,3x33 mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 5 dot. pakietu Nr 8, poz.4

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, o przepływie 96 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 6 dot. pakietu Nr 8, poz.5

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, o przepływie 128 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 7 dot. pakietu Nr 8, poz.6

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, w rozmiarze 16G (1,7x50mm) o przepływie 196 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 8 dot. pakietu Nr 8, poz.7

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci filtra hydrofobowego pełniący taką samą funkcję jak zastawka antyzwrotna, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, w rozmiarze 14G (2,2x50mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW NR 9

Pytanie Nr 1 dot. pakietu Nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na oryginalne maski TecnoL Fluidshield Respirator N95, światowego lidera w produkcji tego typu masek - firmy Halyard (daw. Kimberly-Clark) -

znane i używane z powodzeniem w Państwa Centrum - maski o kształcie „kaczego dzioba”, spełniające w pełni przepisy dotyczące zdrowia publicznego testowania i certyfikacji respiratorów przez NIOSH zgodnie z zasadą US 42 CFR część 84, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

ZESTAW NR 10

Pytanie Nr 1 do pakietu Nr 4 igły do portu :


Prosimy o dopuszczenie alternatywnej igły do portu szlif Hubera w pakiecie 4 poz 1 objętość wypełnienia 0,3 ml, Igła typu motylek, z klipsem zatraskowym na drenie. Igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIa w rozmiarach 20G x25mm,22Gx25mm , opakowanie typu tyvec ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie Nr 2 do pakietu Nr 4 igły do portu :

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej igły do portów w pakiecie 4 poz 2 - Igła Hubera 19Ga x 19 mm, objętość wypełnienia 0,3 ml, Igła typu motylek, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych , **umożliwia podanie środka kontrastującego pod ciśnieniem 300 psi** , igła z klipsem zatraskowym na drenie z oznaczeniem wartości

przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT, w rozmiarach 20Gx19mm,20Gx25mm,22Gx19mm,22Gx25mm , w opakowaniu typu tyvec ?

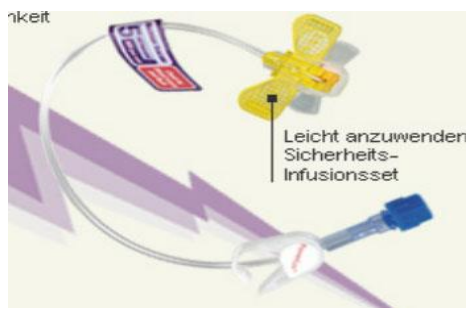

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 3 dotyczy §4 ust. 14 wzoru umowy(Załącznik nr 3 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawienia jednej faktury do jednego zamówienia. Uzasadnienie: Wykonawca wystawia faktury na podstawie ruchu magazynowego i z tego powodu do jednego zamówienia mogą wygenerować się np. dwie faktury. Na fakturach widnieje jednak zawsze numer transportu oraz numer zamówienia Zamawiającego, dzięki czemu identyfikacja dostawy nie jest problematyczna. Ponadto zamówienia mogą być realizowane z dwóch różnych magazynów co uniemożliwia wystawienie jednej faktury. Jeżeli

odpowiedź będzie negatywna prosimy o możliwość podpisania oddzielnych umów do każdego pakietu w razie wygranej .

Odpowiedź: Brak zgody.

Pytanie Nr 4 dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wysokości kar umownych na: „(...) po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 20,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 20 % wartości umowy netto.”

Odpowiedź: Brak zgody.

Pytanie Nr 5 dotyczy §6 ust. 12 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości netto umowy.

Odpowiedź: Brak zgody

Pytanie Nr 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust 13 :

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odpowiedź: Brak zgody

Pytanie Nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopisane w SWZ pkt 8 ppkt .2Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji, itp. zwanych dalej "zezwoleńiami" przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanieo ile dotyczy.

Odpowiedź: Brak zgody

ZESTAW NR 11

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści wycenę kaniuli o opisie:

”Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z sześcioma wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny plastikowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Skrzydełka umożliwiające stabilne umocowanie kaniuli. Korek portu bocznego oraz skrzydełka zgodne z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, z nadrukiem w kolorze granatowym na opakowaniu. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego, co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki. Nazwa producenta na korku portu bocznego. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Skrzydełka mocujące, koreczek luer-lock, pakowana pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i

daty ważności. Opis w języku polskim, sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar: 22G 0,9x25mm o przepływie 36ml/min, 20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min.; 18G 1,3x32mm o przepływie 105ml/min. 18G 1,3x45mm o przepływie 100ml/min.; 17G 1,5x45mm o przepływie 142ml/min., 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min., 14G 2,1x45mm o przepływie 305ml/min.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW NR 12

Pytanie Nr 1 do pakietu Nr 7 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadającej metalowa osłonkę zabezpieczająca przed zakłuciem igłą, która działa automatycznie przy wyjęciu igły

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 2 do pakietu Nr 7 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w opakowaniu typu TYVEC

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie Nr 3 do pakietu Nr 7 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarach i przepływach:

Rozmiar Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
			mm	mm
14G	Pomarańczowy	270	2,1	45
16G	Szary	200	1,8	45
17G	Biały	140	1,4	45
18G	Zielony	85	1,3	32
18G	Zielony	85	1,3	45
20G	Różowy	55	1,1	32
20G	Różowy	55	1,1	25
22G	Niebieski	33	0,9	25
24G	Żółty	19	0,7	19

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Karol Orkiszewski