



WSzSL/DZ/072/ 54 /19

Legnica, 15-02-2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Tytuł Projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

„PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU DO UŻYTKU MEDYCZNEGO MAJĄCEGO STANOWIC WYPOSAŻENIE W WYREMONTOWANYCH PORADNIACH”

znak sprawy WSzSL/DZ-06/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pakiet 14 - MOBILNE LAMPY ZABIEGOWE

Pytanie 1

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której źródłem światła jest 19 białych diod LED, co jest różnicą minimalną, bez żadnego znaczenia użytkowego?

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY

UMOWA Nr/DZ/19 - dotyczy Pakietu 1 w zakresie pozycji 2, Pakietu 2 w zakresie pozycji 2, Pakietu 4 w zakresie pozycji 1-5; Pakietu 6; Pakietu 9, Pakietu 10, Pakietu 11, Pakietu 12, Pakietu 13, Pakietu 14, Pakietów od 16 do 24

Pytanie 4

Czy Zamawiający w paragrafie 2 pkt. 9 zgodzi na:

wydłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 3-4 tygodni? Zamówienie Zamawiającego nie ma charakteru dostaw cyklicznych, nie są to bowiem produkty zużywalne, które wykonawca posiada stale na magazynie, lecz dostawy produktów o wieloletnim charakterze funkcjonowania. 5 dniowy termin zamówienia wydaje się być nieuzasadniony, gdyż dostawy przedmiotu zamówienia można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem.

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamówienie związane jest z dostawami wg. uznania Zamawiającego w okresie do 30.06.2019 roku (Rozdział IV SIWZ).

Pytanie 5

Czy Zamawiający w paragrafie 3 pkt. 1 zgodzi na zmianę na 10 dni?

W odpowiedzi na pytanie: Pytanie nie ma związku z paragrafem 3 pkt. 1

Pytanie 6

Czy Zamawiający w paragrafie 5 pkt. 1 ppkt. c) zgodzi na zmniejszenie wysokości kary? Przewidziana kara jest b. wysoka. Proponujemy karę w wys. 50 zł.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w paragrafie 5 pkt. 1 ppkt. e) zgodzi na zmniejszenie wysokości kary? Przewidziana kara jest b. wysoka. Proponujemy karę w wys. 20 zł.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY

UMOWA Nr/DZ/19 - dotyczy Pakietu 1 poz. 1 oraz od 3 do 6, Pakietu 2 pozycja 1 i 3, Pakietu 3, Pakietu 4 poz. 6, Pakietu 5, Pakietu 7, Pakietu 8, Pakietu 15

Pytanie 8

Czy Zamawiający w paragrafie 2 pkt. 1 zgodzi na:

wydłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 4-5 tygodni? Zamówienie Zamawiającego nie ma charakteru dostaw cyklicznych, nie są to bowiem produkty zużywalne, które wykonawca posiada stale na magazynie, lecz dostawy produktów o wieloletnim charakterze funkcjonowania. 5 dniowy termin zamówienia wydaje się być nieuzasadniony, gdyż dostawy przedmiotu zamówienia można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem.

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamówienie związane jest z dostawami wg. uznania Zamawiającego w okresie do 30.06.2019 roku (Rozdział IV SIWZ).



Pytanie 9

Czy Zamawiający w paragrafie 5 pkt. 1 ppkt. b) zgodzi na zmniejszenie wysokości kary do 3%? Przewidziana kara jest b. wysoka.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w paragrafie 5 pkt. 2 ppkt. 1) zgodzi na zmianę na 10 dni?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 11

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 3-4 tygodni dla przedmiotu umowy opisanego w: Pakietu 1 w zakresie pozycji 2, Pakietu 2 w zakresie pozycji 2, Pakietu 4 w zakresie pozycji 1-5; Pakietu 6; Pakietu 9, Pakietu 10, Pakietu 11, Pakietu 12, Pakietu 13, Pakietu 14, Pakietów od 16 do 24 zgodnie z pytaniami, które zadaliśmy do treści projektu umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 4-5 tygodni dla przedmiotu umowy opisanego w: Pakietu 1 poz. 1 oraz od 3 do 6, Pakietu 2 pozycja 1 i 3, Pakietu 3, Pakietu 4 poz. 6, Pakietu 5, Pakietu 7, Pakietu 8, Pakietu 15 zgodnie z pytaniami, które zadaliśmy do treści projektu umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 14 - Mobilne lampy zabiegowe

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający alternatywnie zaakceptuje lampy o poniższych, zbliżonych do wymaganych parametrach:

MOBILNA LAMPA ZABIEGOWA na statywie jezdnym. Regulacja położenia lampy przy kopule zapewniająca dokładne pozycjonowanie lampy. Okrągły kształt lampy. Lampa zapewniająca dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość. Średnica kopuły 33 cm. Kopuła wyposażona w uchwyty brudne oraz uchwyt wymienny i sterylizowany (2 uchwyty w komplecie). Ramię poruszające się w pionie. Możliwość obrotu kopuły względem dwóch prostopadłych poziomych osi. Ilość źródeł światła - 7 (tylko białe diody LED) wykonane w technice diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy. Regulacja natężenia oświetlenia realizowana płynnie za pomocą pokrętła. Waga – 20 kg. Żywotność źródła światła 30.000 godz. Klasa I zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 8 – Wagi medyczne ze wzrostomierzem

Pytanie 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć

dotychczasowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy projektu umowy w tym zakresie wyłączającym montaż, uruchomienie oraz szkolenie zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „**UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA**” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: $200g < 200\text{ kg} > 500g$?
Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy: 360 x 310 mm?

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny



sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet nr 14 – Mobilne lampy zabiegowe

Pytanie 19

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylizowany (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach czasz uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania lampą (czaszą).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga ilość źródeł światła zapewniającą natężenie oświetlenia na poziomie min. 60 KLX.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga ilość źródeł światła zapewniającą natężenie oświetlenia na poziomie min. 60 KLX.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 (diody białe)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na

komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga ilość źródeł światła zapewniającą natężenie oświetlenia na poziomie min. 60 KLX.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez pokrętko umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik bezdotykowy umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym. Dodatkowo rozwiązanie które eliminuje zakażenia krzyżowe

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakietu nr 10 - lampy bakteriobójcze

Pytanie 27

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy z stali kwasoodpornej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz



numer zapytania).

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez hamulca na kole?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 13 – Spirometr

Pytanie 29

Czy Zamawiający dości spirometr o wymiarach 220x250x52mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 14 - Mobilne lampy zabiegowe

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści 12 diod wykonane w technice diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści realizację natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą dotykowych membranowych przycisków (nie wystających poza konstrukcję lampy)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści wymienny sterylizowany uchwyt (min. dwa uchwyty w komplecie) oraz niesterylny uchwyt w formie łącznika ramienia lampy z kopułą?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze 55 kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pakiet 2 - SPRZĘT MEDYCZNY DO POMIARU CIŚNIENIA ORAZ BADANIA SERCA

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem zapisu od 10 do 80 sek., przy czym pamięć zapisów EKG to 400 badań

Filtr izolacji; do wyboru filtry: 0,05 Hz (3,2 s), 0,10 Hz (1,5 s), 0,25 Hz (0,6 s), 0,50 Hz (0,3 s), 1,50 Hz (0,1 s), splines, Wymiary (D x S x W): 330 x 270 x 74 mm, Waga urządzenia: 3,2 kg ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści stolik z wymagana wysokością, ale z blatem o wymiarach 47x 27 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 36

Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością ciśnieniomierzy z opisu w pkt. 1 parametrów siwz dopuści ciśnieniomierz z tarczą o średnicy 15 cm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z mankietem 1 wężykowym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z koszem z trwałego tworzywa ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 4 - FOTELE MEDYCZNE I STOŁY MEDYCZNE

Pytanie 39

Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością fotela z opisu w pkt. 1 parametrów siwz dopuści fotel ginekologiczny gdzie podstawa oraz kolumna nośna zabezpieczone są osłonami wykonanymi z tworzywa sztucznego , gwarantującymi solidność materiału , brak przestrzeni zamkniętych I trudno dostępnych oraz łatwość I szybkość dezynfekcji ponadto nie narażonymi na korozję w ciągu czasu użytkowania

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych



wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 640-940mm ?
Uzasadnienie: Proponowany zakres jest optymalny dla fotela ginekologicznego , pozwala ponadto w najniższym ustawieniu zająć miejsce pacjentowi bez konieczności korzystania ze schodka, najwyższy zakres pozwala na komfortową pracę nawet wysokiego lekarza.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0 /+200

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacją segmentu pleców w zakresie 0/+80° wspomaganą sprężyną gazową ?

Uzasadnienie : zakres optymalny dla badań I zabiegów ginekologicznych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści wszystkie funkcje elektryczne realizowane za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego?

Uzasadnienie: Rozwiązanie zapewnia nieskrępowany dostęp do panelu sterującego w tym możliwość regulacji w każdej pozycji fotela (kiedy jest w pozycji badania jak I w pozycji rozłożonej fotela – pozycji leżącej)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny ustawiany do pozycji Trendelenburga w zakresie do 20° ?

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie różni się od wymaganego I nie ma wpływu na wartość techniczno-użytkową sprzętu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości leża 1415mm oraz z wysuniętym segmentem nożnym 1905mm?

Uzasadnienie: Parametry optymalne dla przyjmowania pacjentów o różnej wysokości.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 46

Czy Zamawiający w wyposażeniu do fotela dopuści wyjmowaną miskę o pojemności 3l?

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie różni się od wymaganego I nie ma wpływu na wartość techniczno-użytkową sprzętu.




W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 47

Czy Zamawiający w wyposażeniu do fotela dopuści podpórki rąk z tworzywa sztucznego, łatwe w czyszczeniu I dezynfekcji ?

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie nie ulegnie zniszczeniu- zużyciu w czasie użytkowania produktu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

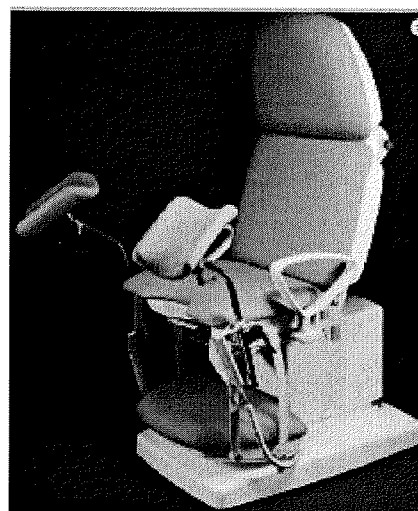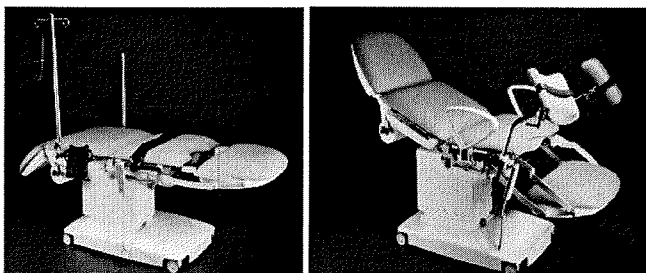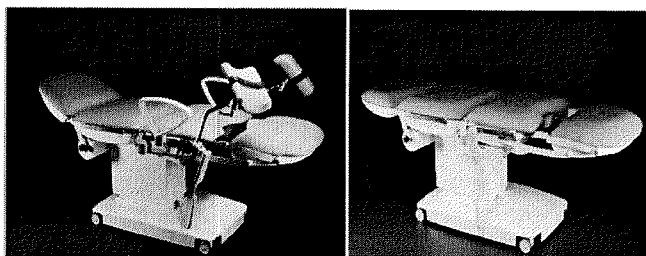

Pytanie 48



Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością fotela z opisu w pkt. 2 parametrów siwz dopuści fotel urologiczny z podpórkami podudzia typu Goepela oraz odejmowaną dużą misą wykonaną ze stali nierdzewnej?
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 49

Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością fotela z opisu w pkt. 3 parametrów siwz dopuści fotel do podawania wlewów bez leża wypełnionego płytą HPL o charakterystyce antybakteryjnej ?

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania wlewów bez profilowanej i poszerzanej części barkowej sekcji pleców?

Uzasadnienie: Parametr nie wpływa na wartość techniczno-użytkową sprzętu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania wlewów bez profilowanej i poszerzanej części barkowej sekcji pleców?

Uzasadnienie: Parametr nie wpływa na wartość techniczno-użytkową sprzętu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania wlewów z komfortowym, nieodpinanym materacem 2 sekcyjnym ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania wlewów z tapicerką wykonaną ze zmywalnego certyfikowanego skaju medycznego, sprawdzonego na przestrzeni 10 lat przez setki użytkowników, bez właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania wlewów wyposażony w kółka o średnicy 75mm z indywidualną blokadą hamulcami ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 54

Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością stołu z opisu w pkt. 4 parametrów siwz dopuści stół zabiegowy którego konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo a całość obudowana jest tworzywową osłoną w kolorze białym ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 640-940mm?

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego\

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z elektryczną regulacją nachylenia segmentu siedziska w zakresie min. od 0 do +20°

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez możliwości regulacji do pozycji anty-Trendelenburga ?

Uzasadnienie: W większości badań I zabiegów z zakresu chirurgii parametr nie jest bezwzględnie wymagany ,ponadto zastosowanie znacznie podroży ostateczną cenę produktu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie min. -10/+70°? .

Uzasadnienie: Parametr optymalny dla regulacji sekcji pleców.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z segmentem nożnym z regulacją w zakresie 0/-90° ?

Uzasadnienie: Parametr optymalny dla regulacji sekcji nożnej pozwalający dla uzyskać pozycje fotela I pozycję

leżącą .

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min 150kg ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z podstawą stołu wyposażoną w koła o średnicy min. 75 mm z indywidualną blokadą bez systemu poziomującego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez szyn montażowych na segmencie nożnym przy jednoczesnym występowaniu szyn montażowych na segmencie siedzenia i segmencie pleców?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy - barierkami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego bez możliwości ich opuszczania a jedynie z możliwością zamocowania na listwie I demontażu z listwy w zależności od zapotrzebowania?

Uzasadnienie: Rozwiązanie jest wygodne i lubiane przez personel , a barierki wykonane z tworzywa sztucznego są lżejsze niż te ze stali nierdzewnej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 5 - WÓZKI INWALIDZKIE

Pytanie 64

Czy Zamawiający w związku z trudną dostępnością wózka z opisu parametrów siwz dopuści wózek inwalidzki dla osób ciężkich o szerokości całkowitej 72 cm przy wymiarach siedziska 55x43 cm, które spełniają opis parametrów?



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 7 - WYPOSAŻENIE MEBLOWE GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości 590-780 mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości 490-620 mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 8 - WAGI MEDYCZNE ZE WZROSTOMIERZEM

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 1000 – 2000 mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści wymiary platformy 319x289 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 13 - SPIROMETR

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści przepływ 16 l/s ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści wymiary 330x270x74mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w od-



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



powiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 1, poz. nr 2: Promiennik

Pytanie 71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania promiennik w wersji ściennej lub w wersji mobilnej.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 72

Czy jeżeli promiennik jest wykonany zgodnie z normą PN-EN 60601-2-21, która wyklucza przewrócenie się urządzenia w warunkach normalnych: takich jak progi oraz kąt nachylenia, to czy Zamawiający odstąpi od wymogu automatycznego wyłączenia się urządzenia po przewróceniu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania promiennik załączany przy pomocy wyłącznika kołyskowego, który jest stosowany prawie we wszystkich urządzeniach medycznych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 74

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pochylania głowicy grzejnej, co w przypadku wersji ściennej jest całkowicie zbędne oraz odbiega od założenia normy PN-EN 60601-2-21 pkt. 201.3.206?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 4, poz. nr 1: Fotel ginekologiczny

Pytanie 75

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając regulację segmentu pleców miał na myśli zakres min. - 5°/+75°?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 76

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając pozycje Trendelenburga miał na myśli wartość 25°?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.



Pakiet 4, poz. nr 2: Fotel urologiczny

Pytanie 77

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając zapis „podpórka pod stopy” miał na myśli dodatkowy dokładany/ odejmowany segment nóg?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o całkowitej długości w pozycji poziomej 1650mm?

W odpowiedzi na pytanie: Tak

Pakiet 4, poz. nr 3: Fotel do podawania wlewów

Pytanie 79

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów wyposażony w podłokietniki z regulacją kąta nachylenia w pionie w zakresie +/-15°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów wyposażony w podłokietniki z regulacją kąta nachylenia w poziomie w zakresie +/-90°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 4, poz. nr 4: Stół zabiegowy

Pytanie 81

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając elektryczną regulację nachylenia segmentu siedziska miał na myśli zakres od -20° do +10°?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 82

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając pozycję Trendelenburga miał na myśli wartość min. 20°?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 83

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając pozycję anti-Trendelenburga miał na myśli wartość



min. 10⁰?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 84

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając regulację segmentu pleców miał na myśli zakres min. 5⁰/+75⁰?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 85

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając regulację segmentu nóg miał na myśli zakres min. +5⁰-85⁰?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pakiet 4, poz. nr 5: Stół do zakładania opatrunków gipsowych

Pytanie 86

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając regulację segmentu pleców sprężyną gazową miał na myśli zakres 0⁰/+80⁰?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pakiet 7, poz. nr 2: Taboret

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret lekarski z regulacją wysokości siedziska przy pomocy podnośnika gazowego w zakresie 440-560mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret lekarski z regulacją wysokości siedziska przy pomocy podnośnika gazowego w zakresie 595-850mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 12, poz. nr 1: Unit laryngologiczny

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w wysuwane oparcie głowy, regulowane w zakresie 50-300mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 90

W związku z aktualnie prowadzoną przez Państwa procedurą przetargową zwracamy się z prośbą o dopuszczenie unitu laryngologicznego o następujących parametrach:

1	Unit laryngologiczny
2	Unit laryngologiczny jednomodułowy, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem właściwości antybakteryjnych farby) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej
3	Powierzchnia unitu wykonana z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej.
4	Unit o wymiarach: - szerokość unitu: 1100 mm \pm 50mm - głębokość: w granicy: 500 mm \pm 50mm
5	Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm \pm 20 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiającą umieszczenie pudełka zawierającego minimum 100 szt. rękawiczek jednorazowych
6	Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan.
7	Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit.
8	Możliwość dobrania różnych kolorów dla minimum 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu
9	Panel sterowania umiejscowiony z prawej lub lewej strony (do wyboru). Od frontu pod łatwozmywalną taflą szkła w celu lepszej dezynfekcji, umiejscowiony jest m.in. manometr ssaka, wyświetlacz aktualnej i ustawionej temperatury wody, przyciski funkcyjne.
10	Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych.
11	Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz komenda informująca o „zapchanym” pojemniku na wydzielinę.
12	Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 - 100% mocy
13	Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz lusterek włączany przyciskiem i wyłączający się samoczynnie po upływie 14 - 16 sek.
14	Min. 6 wbudowanych pojemników/kuwet do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 3 kuwety podgrzewane
15	Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania



16	Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady(wysokość frontu szuflady min. 120 mm) z mechanizmem miękkiego domykania
17	Kuweta do wstępnej dezynfekcji ze stali nierdzewnej lub melaminy na brudne narzędzia wysuwana z unitu w wkładką typu język wraz z pokrywką
18	Unit w dolnej części posiadający samozamykającą śmietniczkę otwierana nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji
19	Uchwyt na lampę czołową usytuowany w bocznej części unitu z regulacją wysokości
20	Ruchomy wysięgnik z miejscem dla: dren ssaka, rączkę do irygacji i światłowód
21	Kolumna monitora mocowana bezpośrednio do unitu
22	Uchwyt monitora mocowany do kolumny
23	Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
24	Unit wyposażony w min. jeden światłowód 4,8 mm z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm
25	Unit wyposażony w min. 2 podgrzewane kuwety na endoskopy o średnicy 4 mm- kuweta z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia i dezynfekcji
26	Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuweta z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia i dezynfekcji
27	Podgrzewane kuwety posiadają płynną regulację temperatury
28	Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i podciśnieniu -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną
29	Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra
30	Unit wyposażony w manometr siły ssania oraz regulator do płynnej regulacji siły ssania
31	Automatycznie opróżniany zbiornik ssania z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem.
32	Układ płukania drenu ssaka za pomocą wody pod ciśnieniem wytwarzanym przez unit
33	Płukanie ucha (irygacja) - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min.
34	Rękojeść irygacji wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca osłonę przeciwrozpryskową ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji. Kaniule odkręcane/wymienne.
35	Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże
36	2 poziomy podświetlany blat na instrumentarium o szerokości wewnętrznej w granicach 700mm ±20 mm, wyposażony w stalowe tace, zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału
37	Zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy
38	Dodatkowa półka zintegrowana z unitem wykonana ze szkła akrylowego usytuowana w górnej



	części unitu nad instrumentarium na wysokości 1300 mm ± 50mm, o szerokości przestrzeni instrumentarium.
39	Kamera medyczna
40	Kamera medyczna Głowica kamery PAL z przetwornikiem 1/3 " CCD Rozdzielczość przetwornika min. 752x582 Pixeli Głowica posiada min. 3 programowalne przyciski funkcyjne pozwalające na zaprogramowanie 6 funkcji Procesor kamery posiada ustawienia dla min. 5 różnych ustawień/użytkowników Procesor kamery posiada m.in.: - filtr dla nasopharyngoskopów likwidujący tzw. "efekt mora" - funkcje zamrażania obrazu „Freeze” Procesor kamery posiada wyjścia min. 2 x S-Video (do podłączenia monitora) i videograbbera Możliwość podłączenia klawiatury komputerowej w celu wpisania danych pacjenta Waga głowicy kamery (bez obiektywu i przewodu) max. 90g
41	Monitor medyczny
42	Monitor medyczny min. 17" w kolorze białym z frontem pokrytym szkłem ułatwiającym utrzymanie monitora w należytej czystości, wejścia/wyjścia : VGA, DVI, S-Video, Tryb podświetlenia do łatwego prześwietlania i oglądania klisz RTG
43	Fotel pacjenta
44	Fotel laryngologiczny z regulacją siedziska góra/dół, zmianą położenia oparcia pleców, posiadający zagłówek i podnóżek
45	Podłokietniki odchylane na boki z możliwością szybkiego demontażu
46	Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 490 - 680 mm, regulacja przez sterownik nożny
47	Fotel umożliwia obrót 360° wokół osi i blokady w dowolnej pozycji
48	Podstawa fotela na nóżkach pozwalających na wypoziomowanie fotela
49	Zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół, przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy
50	Możliwość wyboru koloru tapicerki fotela spośród przynajmniej 25 kolorów
51	Nośność fotela min. 130 kg
52	Krzesełko lekarskie
53	Wysokość siedziska regulowana w zakresie 53-66 cm
54	Podstawa na pięciu podwójnych kółkach
55	Podnóżek pierścieniowy
56	Oparcie dla pleców z regulacją głębokości
57	Lampa czołowa



58	Lampa czołowa, bezprzewodowa LED z akumulatorem na czepcu - Czepiec z regulacją obwodu i głębokości - Akumulator Li-Ion min. 700mA - Dystans pracy w przedziale min. 20-60cm - Średnica plamki światła zależna od dystansu min. 8-115mm - Czas pracy min. 3,5 godziny - Waga lampy z akumulatorami max. 350g - W komplecie ładowarka sieciowa
59	Endoskopy
60	Optyka 0 ⁰ , Ø 3mm, 50mm ±5mm
61	Optyka 0 ⁰ , Ø 2,7mm, 110mm ±5mm
62	Optyka 30 ⁰ , Ø 2,7mm, 140mm ±5mm
63	Optyka krtaniowa „Laryngoskop” 70 ⁰ , Ø 8,5 mm, dł. 210mm ±5mm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pakiet 14 – mobilne lampy zabiegowe

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 32cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada uchwytu brudnego, lecz zgodnie z wymaganiem będzie posiadać wymienny i sterylizowany uchwyt tzw. „czysty”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 16 diod LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniową regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez wymiennego i sterylizowanego uchwytu, lecz z dwoma tzw. uchwytami brudnymi do pozycjonowania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła na poziomie 30 000h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Pytanie nr 100

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy poprzez wymóg posiadania przez unit: cicha pompa podciśnieniowa: 1 szt oraz ssak medyczny: 1 szt Zamawiający wymaga aby oferowany unit posiadał dwa urządzenia ssące czy za spełnienie warunku uzna jeżeli unit będzie posiadał wbudowaną cichą pompę podciśnieniową pełniącą funkcję ssaka medycznego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga wbudowany system ssania aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną.



Pytanie nr 101

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy poprzez wymóg posiadania przez unit: pistolet natryskowy: 4 szt oraz pistolet nadmuchowy : 1 szt – Zamawiający wymaga dostarczenia 5 pistoletów, które wytwarzają nadciśnienie czy za spełnienie warunku uzna dostarczenie unitu posiadającego system sprężonego powietrza z możliwością podłączenia rękojeści służącej do podawania płynów i proszków w formie spreju?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza dostarczenie unitu posiadającego system sprężonego powietrza z możliwością podłączenia rękojeści służącej do podawania płynów i proszków w formie spreju.

Pytanie nr 102

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Zamawiający wymaga aby unit posiadał Pistolet ssący: 1 szt, czy za spełnienie warunku uzna dostarczenie unitu posiadającego wbudowany system ssący wyposażony w dren, do którego można podłączyć końcówki ssące?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający uzna dostarczenie unitu posiadającego wbudowany system ssący wyposażony w dren do którego można podłączyć końcówki ssące pod warunkiem, że dren ssaka będzie antybakteryjny.

Pytanie nr 103

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany unit posiadał podłączenie do bieżącej wody oraz kanalizacji?

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zamawiający wymaga unit z podłączeniem do instalacji wodno – kanalizacyjnej (dopływ bieżącej wody oraz odpływ kanalizacji).

Pytanie nr 104

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy za spełnienie warunku posiadania przez unit źródła światła 50W LED : 1 szt, Zamawiający uzna wyposażenie unitu w źródło światła LED o mocy równoważnej 250W źródła światła ksenonowego?

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamawiający wymaga wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0-100% mocy.

Pytanie nr 105

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy za spełnienie warunku posiadania przez unit zautomatyzowanego ramienia: 1 szt, Zamawiający uzna wyposażenie unitu w zestaw uchwyty na akcesoria, które oferują automatyczne włączenie / wyłączenie poszczególnych funkcji unitu poprzez podniesienie / odłożenie poszczególnych akcesorii, np. kamera endoskopowa, wąż ssaka, rękojeść systemu sprężonego powietrza?

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamawiający wymaga ruchomy wysięgnik z miejscem dla: dren ssaka, rączkę do irygacji i światłowód opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 106

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Proszę o doprecyzowanie opisu Zestaw sprzętu: 2szt. Czy Zamawiający wymaga aby unit był wyposażony w dwa zestawy narzędzi laryngologicznych, a jeżeli tak to jakich?

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamawiający wymaga 2 – poziomy, podświetlany blat instrumentarium o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 107

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy za spełnienie warunku posiadania przez unit szuflady na komputer: 1 szt, Zamawiający uzna wyposażenie unitu w budowany komputer klasy PC służący do sterowania funkcjami unitu oraz umożliwiający rozszerzenie



unitu o dodatkowe funkcje / programy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgodny.

Pytanie nr 108

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit posiadający wymiary: szerokość 1522mm głębokość: 828mm, wysokość: 960mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 109

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy Zamawiający wymaga aby funkcje sterowania elektrycznego fotelem pacjenta były realizowane z panelu dotykowego unitu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 110

Dotyczy Pakiet 12 – unit laryngologiczny

Czy Zamawiający wymaga aby unit był wyposażony w kamerę endoskopową HD?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga aby unit wyposażony był w kamerę endoskopową HD. Jednocześnie informujemy, iż w opisie przedmiotu zamówienia został omyłkowo pominięty wymóg posiadania kamery. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

UWAGA!

1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający informuje, że niektóre ze zmian w SIWZ dokonane w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz z własnej inicjatywy zaznaczono czcionką koloru czerwonego.
3. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 25-02-2019 roku na dzień 04-03-2019 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik