



EZ.272.059.2024

Wrocław, dnia 2025.02.14

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH (sygnatura sprawy EZ/272/059/24)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zadanie 9, poz 187. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe typ Hartman? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 2

Zadanie 9 , poz 188. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe typ Hartman? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 3

Zadanie 9, poz 189. Czy zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny typ Baby-Collin max 80mm, łyżki 23x42 mm i 30x42 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 4

Zadanie 9, poz 190. Czy zamawiający wyraża zgodę na parę łyżek bocznych do haka brzusznego Loktite-Collin 23x42 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 5

Zadanie 9 , poz 191. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne super ostre typ Baby-Metzenbaum dł. 110 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 6

Zadanie 9, poz 192. Czy zamawiający wyraża zgodę na hak brzuszny typ Mikulicz wymiary części roboczej 90x50 mm dł. 260mm ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 7

Zadanie 9, poz 196. Czy zamawiający wyraża zgodę na haczyki typ Guthrie dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 8

Zadanie 9, poz 197. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło plastyczne typ Derf dł. 120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 9

Zadanie 9, poz 198. Czy zamawiający wyraża zgodę na kimadło plastryczne typ Converde-Derf dł. 120 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 10

Zadanie 9, poz 200. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki ostre dł. 110mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 11

Zadanie 9, poz 201. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki typ Bawbridge dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 12

Zadanie 11, poz 207. Czy zamawiający może napisać wymiary młotka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga młotka o wadze 250g $\pm$ 25g i średnicy 30mm $\pm$ 2 mm oraz długości 190mm $\pm$ 5 mm.

Pytanie 13

Zadanie 13, poz 222. Czy zamawiający wyraża zgodę na hak typ Baby-Roux dł. 125 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 14

Zadanie 13, poz 224. Czy zamawiający wyraża zgodę na haki typ Farabeuf dł. 115 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 15

Zadanie 13, poz 230. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki typ Bawbridge dł. 180 mm?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 16

Zadanie 13, poz 239. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki typ Allis dł. 150 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 17

Zadanie 13, poz 240. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki typ Baby-Allis dł. 125 mm?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 18

Zadanie 13, poz 244. Czy zamawiający wyraża zgodę na końcówka do ssania, typ Frazier 45 st. Dł 180 mm lub według nr katalogowego Aesculap 30 st, dł. 90 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga długości narzędzia równego 100 mm $\pm$ 5 mm zgodnego z podanym numerem katalogowym.

Pytanie 19

Zadanie 13, poz 241. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło typ Converse- Derf dł. 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 20

Zadanie 13, poz 253. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Metzenbaum dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 21

Zadanie 13, poz 254. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum dł. 110 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 22

Zadanie 13, poz 256. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki opatrunkowe Standard dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.





Pytanie 23

Zadanie 13, poz 257. Czy zamawiający wyraża zgodę na spinaki tepe dł. 135 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 24

Zadanie 16, poz 302. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęste uszna Lucae bagnetowa dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 25

Zadanie 16, poz. 304. Czy zamawiający wyraża zgodę na lusterko krtaniowe dł. 190 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 26

Zadanie 18, poz. 323. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum-Fino TC dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 27

Zadanie 18, poz. 327. Czy zamawiający wyraża zgodę na Pęseta Cushing dł. 170 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 28

Zadanie 18, poz. 332-334. Czy zamawiający wyraża zgodę na retractor Volkamnn dł. 220mm? Pozostałe parametry w pozycjach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 29

Zadanie 18, poz. 335. Czy zamawiający wyraża zgodę na retractor Volkmann dł. 220 mm? Czy zamawiającemu chodziło o retractor Volkamnn 6 zębów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza retractor Volkmann dł. 220 mm, ale nie czyni wymogu. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga 6 zębów w pozycji 335.

Pytanie 30

Zadanie 18, poz. 344. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe Hartman dł. 100mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 31

Zadanie 18. poz. 346. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe Rochester-Carmalt? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 32

Zadanie 18. poz. 357. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze jelitowe Doyen dł. 235 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 33

Zadanie 18. poz. 358. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze jelitowe Mayo-Robson, atraumatyczne, dł. 250 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 34

Zadanie 18. poz. 360. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Doyen Atraumatic dł. 235mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 35

Zadanie 18. poz. 361. Czy zamawiający wyraża zgodę na sondę do przetok dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 36

Zadanie 19. poz. 362. Czy zamawiający wyraża zgodę na wziernik donosowy Cottle dł. 75 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 37

Zadanie 19. poz. 363. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum-Lahey dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 38

Zadanie 19. poz. 364. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki super Cut typ Mayo-Stile? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 39

Zadanie 19. poz. 369. Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło Webster TC dł. 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 40

Zadanie 19. poz.373. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe typ Pean? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 41

Zadanie 19. poz. 374. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze typ Pean? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 42

Zadanie 21. poz. 379. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęsetę anatomiczną dł. 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 43

Zadanie 21. poz. 380. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęsetę anatomiczną dł. 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 44

Zadanie 21. poz. 381. Czy zamawiający wyraża zgodę na pęsetę chirurgiczną dł. 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 45

Zadanie 21. poz. 382. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze typ Kocher dł 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 46

Zadanie 21. poz. 389. Czy zamawiający wyraża zgodę na łyżeczka dł. 220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 47

Zadanie 21. poz. 390. Czy zamawiający wyraża zgodę na igła kulkowa 1,2x89 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 48

Zadanie 21. poz. 391. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 49

Zadanie 21.poz. 392. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 50

Zadanie 21. poz. 393. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 230 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 51

Zadanie 22. poz. 404. Czy zamawiający wyraża zgodę na hak typ Us-Army wymiary łyżek: 25x15mm,40x15mm; 21x15mm,45x15mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 52

Zadanie 22. poz. 407. Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 53

Zadanie 22. poz. 411. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze repozyc do dużych kości dł. 205mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 54

Zadanie 22. poz. 415. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze preparacyjne typ Overholt-Geissendörfer dł. 210 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 55

Zadanie 23. poz. 416. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Standard dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.





Pytanie 56

Zadanie 23. poz. 417. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 57

Zadanie 25. poz. 427. Czy zamawiający wyraża zgodę na trzonek skalpoela nr 3 z miarką dł. 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 58

Zadanie 25. poz. 434. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Allis-Boys dł. 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 59

Zadanie 25. poz. 436. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Super Cut Metzenbaum dł. 180mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 60

Zadanie 25. poz. 438. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Gemini? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 61

Zadanie 25. poz. 442. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Micro-Mosquito dł. 125mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 62

Zadanie 25. poz. 443. Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze Micro-Mosquito dł. 125 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.


Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny Ad.187. kleszczyki hemostatyczne delikatne MICRO-MOSQUITO, proste, dł. 10 cm ?






Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

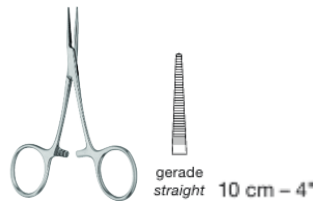

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 64

Ad.188. kleszczyki hemostatyczne delikatne MICRO-MOSQUITO, zagięte, dł. 10 cm ?

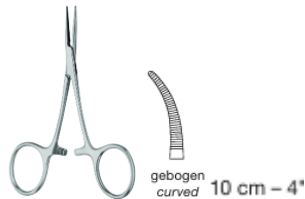

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 65

Ad.189. retraktor automatyczny COLLIN, brzuszny, rozwarcie 110mm, wymiary łopatek 38x80mm ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 66

Ad.190. dwie łyżki boczne o wymiarach 38 x 100 mm do Retraktora ?



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 67

Ad.192. hak brzuszny MIKULICZ, (wątrobowy) zagięty 90 stopni, wymiary łopatki 90x50mm, płaska rękojeść, ażurowa, dł. 26cm ?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 68

Ad.197. imadło do szycia DERF, proste, utwardzane wkładką węglową TC, gęstość żebrowania 3600tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, rozm.0,4 mm, dł. 12,5 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 69

Ad.198. imadło chirurgiczne do szycia CONVERSE, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,2 mm, gęstość żebrowania 14400 tpsi, dł. 12,5cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 70

Ad.199. nożyczki delikatne SuperCut, zakrzywione, ostro-ostre, dł. 11,5 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 71

Ad.200. nożyczki operacyjne, delikatne, ostro-ostre, proste, dł. 10.5cm ?





Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 72

Ad.202. kleszcze hemostatyczne CRILE, 1x2 zęby, proste, dł. 14,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny Ad.222. Hak do ran BABY-ROUX, obustrony, wym. 17x16mm/18x22mm, dł. 13 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 74

Ad.224. Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) FARABEUF, dł. 12 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 75

Ad.225. Haczyk do ran CRILE, obustronny, łopatki o wym. 12x4mm i 20x6mm, dł. 11cm ?



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 76

Ad.227. Łyżka środkowa do haka brzuszego BABY-BALFOUR, wymiary 23x20mm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 77

Ad.228. Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, 1x2 zęby, proste, dł. 16 cm ?



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 78

Ad.230. Kleszcze hemostatyczne JACOBSON, lekko zakrzywione, bardzo delikatne, dł. 13 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 79

Ad.232. Kleszcze hemostatyczne KELLY, zakrzywione, dł. 14,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 80

Ad.233. Kleszcze hemostatyczne KELLY, proste, dł.14,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 81

Ad.237. Kleszczyki hemostatyczne delikatne MICRO-MOSQUITO, zagięte, dł. 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 82

Ad.238. Kleszczyki hemostatyczne delikatne MICRO-MOSQUITO, proste, dł. 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 83

240. Kleszczyki do chwytania jelit i tkanek BABY-ALLIS, 4x5 zęby, dł. 14 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 84

241. Imadło chirurgiczne do szycia CONVERSE, proste, utwardzane wkładką węglową TC, rozm. 0,2 mm, gęstość żebrowania 14400 tpsi, dł. 12,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Pytanie 85

242. Imadło do szycia BABY CRILE WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000tpsi, szerokość brasz 1,5mm, dł. 15 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 86

243. Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, szczelinowe, dł. 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 87

244. Kaniuła ssąca FRAZIER, zakrzywiona, oznaczona kalibracja 5-9 cm, śr. 3,3 mm (10 Charr./Fr.), z kontrolą ssania, dł. części roboczej 10 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 88

Ad.247. Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 zęby, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 14,5 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 89

Ad.251. Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 14,5 cm





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 90

Ad.254. Nożyczki preparacyjne BABY-METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, bardzo precyzyjne, jedna barsza z mikroząbkami, dł. 11,5 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 91

255. Nożyczki delikatne SuperCut, zakrzywione, ostro-ostre, dł. 11,5 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 92

256. Nożyczki operacyjne STANDARD, proste, tępo-tępe, dł. 14,5cm ?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 93

Ad.303. Pęseta anatomiczna JANSEN-GRUENWALD, bagnetowa, szer. 2,2 mm, dł. 16 cm ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 94

Ad.304. Lusterko laryngologiczne



Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 95

Dotyczy zadania 9 poz. 192 Czy Zamawiający dopuści hak o długości 255mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 96

Dotyczy zadania 9 poz. 197 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 97

Dotyczy zadania 9 poz. 198 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 98

Dotyczy zadania 21 poz. 379 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 115mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 99

Dotyczy zadania 21 poz. 380 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Pytanie 100

Dotyczy zadania 21 poz. 381 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia. Jednocześnie informuję, że dokonał omyłki pisarskiej i wymagana długość zgodnej z podanym numerem katalogowym czyli 180mm.

Pytanie 101

Dotyczy zadania 21 poz. 381 Czy Zamawiający dopuści 180 mm? Taka jest długość pęsety o wskazanym numerze referencyjnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych pęsety zgodnych z podanym numerem katalogowym, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 102

Dotyczy zadania 21 poz. 382 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 210mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 103

Dotyczy zadania 21 poz. 382 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 140mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 104

Dotyczy zadania 21 poz. 383 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 210mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 105

Dotyczy zadania 21 poz. 383 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 106

Dotyczy zadania 21 poz. 384 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 107

Dotyczy zadania 21 poz. 385 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 108

Dotyczy zadania 21 poz. 389 Czy Zamawiający dopuści łyżeczki o długości 240mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.





Pytanie 109

Dotyczy zadania 22 poz. 411 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 205mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 110

Dotyczy zadania 23 poz. 418 Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o długości 150mm lub 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 111

ZADANE 33 poz. 557 Prosimy o dopuszczenie szczypiec bipolarnych bagnetowych, nieprzywierających

165 mm, 0,5mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 112

poz. 560 Prosimy o dopuszczenie szczypiec bipolarnych bagnetowych, nieprzywierających 220mm, 0,5mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 113

poz. 561 Prosimy o dopuszczenie szczypiec bipolarnych prostych, 110mm, 6mm, końcówka 0,5mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 114

poz. 563 Prosimy o dopuszczenie szczypiec bipolarnych prostych, nieprzywierających 165mm, 8mm, końcówka 1mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 115

poz. 564, 565 Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Pytanie 116

Pytania do SWZ dla Zadania: 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35

Czy Zamawiający wymaga, aby narzędzia z Zadań 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35 posiadały **znak CE**, dokumenty świadczące, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz 974) w szczególności, certyfikat zgodności z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) lub w Rozporządzeniu 2017/745 (MDR) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały znak CE, dokumenty świadczące, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz 974) w szczególności, certyfikat zgodności z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) lub w Rozporządzeniu 2017/745 (MDR).

Pytanie 117

Czy Zamawiający wymaga, aby producent dostarczył deklarację zgodności dla narzędzi - jedną odrębną deklarację dla każdego z pakietów, w tym dla zadań: 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby producent dostarczył deklarację zgodności dla narzędzi - jedną odrębną deklarację dla każdego z pakietów.

Pytanie 118

Czy Zamawiający wymaga, aby narzędzia były matowione dla uniknięcia refleksu w polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby narzędzia były matowione dla uniknięcia refleksu w polu operacyjnym.

Pytanie 119

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone narzędzia były wykonane zgodnie z normami:

ISO 14971, ISO 17664, ISO 17665-1, EN ISO 10993-1:2009, ISO 7153-1:2016, DIN 58298, DIN EN ISO 13402, EN 10088-1:2007, potwierdzonymi dokumentem wystawionym od wytwórcy/producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dostarczone narzędzia były wykonane zgodnie z normami: ISO 14971, ISO 17664, ISO 17665-1, EN ISO 10993-1:2009, ISO 7153-1:2016, DIN 58298, DIN EN ISO 13402, EN 10088-1:2007, potwierdzonymi dokumentem wystawionym od wytwórcy/producenta

Pytanie 120

Zadanie 2 poz. 46 oraz poz. 55 Czy Zamawiający pozwoli na dopuszczenie dla tych pozycji innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla tych pozycji innego producenta.

Pytanie 121

Zadanie 11 poz. 207. Czy Zamawiający pozwoli na dopuszczenie dla tej pozycji innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla tej pozycji innego producenta.



Pytanie 122

Zadanie 11 poz. 207. Czy Zamawiający dopuści młotek o wadze 250g i średnicy 30mm oraz długości 190mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 123

Zadanie 15 poz. 286. Czy Zamawiający pozwoli na dopuszczenie dla tej pozycji innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla tej pozycji innego producenta.

Pytanie 124

Zadanie 17 poz. 315. Czy Zamawiający pozwoli na dopuszczenie dla tej pozycji innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla tej pozycji innego producenta.

Pytanie 125

Zadanie 21poz. 381. Czy Zamawiający nie popełnił błędu, czy wymagana pęseta powinna mieć długość 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał pęsety o długości 180 mm.

Pytanie 126

Zadanie 35 poz. 581. Czy Zamawiający pozwoli na dopuszczenie dla tej pozycji innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla tej pozycji innego producenta.

Pytanie 127

Zadanie nr 14 Pozycje od 258 do 263 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwoleżynowych wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokrytych powłoką poliuretanową. Prosimy o odstąpienie od wymogu „wodoszczelne”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 128

Zadanie nr 14 Pozycja 263 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera przeciwoleżynowego pod głowę w pozycji brzusznej dla dzieci o wymiarach 273x220x135mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie 129

Zadanie nr 14 Pozycje 270 do 273 Prosimy o zmianę w Formularzu asortymentowym – cenowym stawki podatku Vat z 8% na 23 %, ponieważ pasek silikonowy nie został sklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i nie mamy podstaw do zastosowania obniżonej stawki Vat 8 % , tylko zastosujemy 23 % Vat.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu potwierdzenia wyrobu medycznego dla zadania nr 14 poz. 270 do 273.

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 130

Zadanie 32 kleszczyki laparoskopowe Pozycja 556 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Maryland, wielorazowe o długości 34-35cm i średnicy 5mm z odłączanym przewodem z insertem wielorazowego użytku współpracujące z diatermią KLS Martin

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Renata Kolpenicka
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl