



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

ul. Niechorska 27
72 – 300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/29/1/24

Data

Gryfice 2024-06-25

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę obłożeń operacyjnych oraz pieluchomajtek dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym 55g/m² (łącznie gramatura 110g/m²).

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50µm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 80g/m²

Osłona na stolik MAYO wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura 115g/m²). Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

Opakowanie jednostkowe z 4 etykietami do archiwizacji zawierającymi min. Nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości





wyboru.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 1

czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, poz., 2

czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarach L oraz XL/XXL?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 – 160 cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140 cm)?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 – 170 cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160 cm)?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści podkład ze spodnią warstwą z folii, która nie jest antypoślizgowa?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia podkład chłonny 60x90cm, z poziomem chłonności co najmniej 1150 g?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy **Pakiet nr 9, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład i prześcieradło w kolorze zielonym i niebieskim do swobodnego wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy **Pakiet nr 9, poz. 1 i 2**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury wymaga Zamawiający.

ODP.: 25g/m².





Dotyczy Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m², włóknina 20 g/m², włóknina na spodzie 45 g/m², PE 18 g/m², 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm.



114x150cm
x1

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny wykonany z włókniny Spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?



160/240x180cm x1, 75x90cm x1, 30x30cm x4, 10x50cm x1, 80x145cm x1, 150x190cm x1

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm





- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²?
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach, zestaw sterylizowany radiacyjnie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.




ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach, zestaw sterylizowany radiacyjnie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm oraz z dwoma organizatorami przewodów. Rozmiar wzmocnienie w strefie krytycznej 75cm x 100cm.
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów



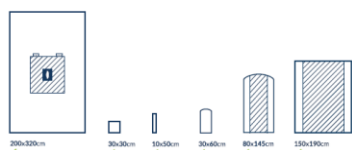

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie i parametrach, zestaw sterylizowany radiacyjnie:

1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywne filtry oraz port umożliwiające podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm, serweta wykonana z transparentnej folii o gramaturze 80g/m²

4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 300cm x 170cm bez wzmocnienia?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną w obszarze krytycznym 230cm x 260cm U przylepne 20cm x 100cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 1 sekcja 30cm x 40cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw ssaków ortopedycznych rozmiar: CH24 (5,60mm/8,00mm) 300cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami w ilości 5 szt.?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 300cm x 170cm bez wzmocnienia?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną w obszarze krytycznym 230cm x 260cm U przylepne 20cm x 100cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 1 sekcja 30cm x 40cm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw ssaków ortopedycznych rozmiar: CH24 (5,60mm/8,00mm) 300cm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami w ilości 5 szt.?
ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?
ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm
- 10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
- 10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski
- 1 szt. Chwytnak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Strzykawką dwuczęściową w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer
- 1 szt. Strzykawką dwuczęściową w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm
- 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Wykonawca wyceniając pozycję pierwszą, w opakowaniu mniejszym niż wskazał Zamawiający, powinien przeliczyć zapotrzebowanie roczne w opakowaniach Zamawiającego?
ODP.: Tak.

Pakiet 13 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są





aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna porodowa 114cm x 150cm 2-warstwowa wzmocniona, z torbą do zbiórki płynów 78cm x 80cm
- 1x Kocyk flanelowy 75cm x 160cm
- 10x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
- 1x Zaciskacz do pępowiny biały
- 1x Nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe 12cm
- 1x Nożyczki do cięcia krocza BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm
- 1x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1x Czapeczka dla noworodka
- 1x Serweta chłonna 60cm x 80cm
- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik chłonny 30cm x 30cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tufery ze znacznikiem RTG , 17 nitek?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kocyk dla noworodka 80cm x 100cm?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 1 sekcja 30cm x 40cm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści czapeczkę dla noworodka w kolorze białym?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17N 6W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH30, lejek-lejek)?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tampon z gazy, 17 nitek?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 13 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do cięcia cesarskiego 200cm x 320cm, otwór 25cm x 30cm?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

1. Pakiet 6, Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 950 g wg ISO 11948-1 czyli takie jak na dzień dzisiejszy są użytkowane/dostarczane?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 6, Poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o standardowym poziomie chłonności, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym nieprzyjemny zapach, z czterema przylepcorzepami, które są wielokrotnego użytku i tym samym umożliwiają idealne dopasowanie pieluchomajtki do obwodu pacjenta, dodatkowo niweluje to występowanie obtarć w talii u pacjentów z nadwagą, przylepce zapewniają trwałe mocowanie, miękka warstwa zewnętrzna, wilgotność utrzymywana wewnątrz, z daleka od skóry, paroprzepuszczalność redukująca powstawanie odparzeń i odleżyn?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 6, Poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z czterema przylepcorzepami z warstwą paroprzepuszczalną w części centralnej, włóknina w obszarze bioder?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 6 Poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g wg ISO 11948-1 100g nie jest znacząca dla użytkownika, a umożliwia złożenie konkurencyjnej oferty?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 6, Poz. 1,2: Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić tolerancję rozmiaru do 10 cm? Dla przykładu aktualne w SWZ 5% od 160 cm daje tolerancje 8 cm więc określenie 10cm jest o nieznaczącej różnicy. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty z większej ilości ofert.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 6, Poz.1: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki L o obwodzie 100-150 cm, umożliwia to złożenie konkurencyjnej oferty?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 6, Poz.2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki XL o obwodzie 130-170 cm, umożliwia to złożenie konkurencyjnej oferty?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.


8. Pakiet 6, Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 1600 g wg ISO 11948-1 100g nie jest znacząca dla użytkownika, a umożliwia złożenie konkurencyjnej oferty?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.





9. Pakiet 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

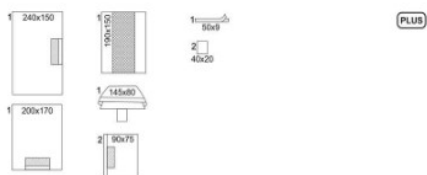

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W
10X20CM

2

SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL
5X60CM

1

SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL
5X60CM

1

SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL
5X90CM

2

POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ
CHŁONNĄ
76X85CM NIEBIESKI

1

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM
190X150CM

1

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM
PRZYL

1

Zestaw uniwersalny wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (polipropylen, polietylen) o gramaturze 62g/m² z dodatkowymi łatanami chłonnymi w strefie krytycznej o całkowitej gramaturze 125 g/m², odporny na przenikanie płynów > 450cm H₂O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o absorpcji 549%. Serwety w zestawie zgodne z normą PN-EN ISO 13795 1-3 pakowany sterylnie w blister. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw zawierający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

10. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy.”?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

W zawiązku z wymogiem SWZ dot. Dostarczenia próbek do postępowania, oraz krótkim czasem na przygotowanie oferty od momentu w którym zamawiający może opublikować odpowiedzi. Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.





PAKIET 1

- Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do porodu w rozmiarze 100 cm x 120 cm, z mankietem w górnej części o szerokości 20 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji ginekologicznej o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm)	250/280 x 280
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
1 ręcznik celulozowy	30 x 33
Opakowanie dodatkowe - papier krepowany	

Główna serweta zestawu wykonana jest z włókniny o łącznej gramaturze min. 49 g/m², bez dodatkowej łąty chłonnej.

Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SWZ.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

LUB

- Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji ginekologicznej o parametrach jak w pytaniu powyżej, z serwetą na stolik Mayo pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 200
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

- Pad chłonny 50cm x 75 cm
- Pad chłonny 50cm x 75 cm
- Pad chłonny 37,5 cm x 90 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 49 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 104 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019. Wytrzymałość materiału na wypychanie na sucho/mokro dla strefy krytycznej -powyżej wymagań SWZ, zdolność absorpcji cieczy dla strefy krytycznej - min. 365ml/m².

Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymaganiami SWZ.





ODP.: Zgodnie z SWZ.

PAKIET 2

4. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji barku o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyn (otwór 12 cm). Wbudowane dwa uchwyty Velcro	225 x 400
1 samoprzylepna serweta operacyjna	75 x 90
1 osłona na kończyne	25 x 80
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Złożona teleskopowo

Sterylnie obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 49g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 150 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 132 kPa i na mokro min. 126 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność na całej powierzchni serwety min. 195 %. tj. min 110 ml/m². Na etykiecie głównej min. 2 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu.

ODP.: Zgodnie z SWZ.


5. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do kraniotomii, w którym obłożenie stolika Mayo składane jest teleskopowo, ręczniki celulozowe mają rozmiar 30 cm x 33 cm oraz zestaw zawiera dodatkowo 2 uchwyty typu Velcro. Pozostały skład zestawu bez zmian.

Sterylnie obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 o gramaturze min. 49 g/m². W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna o gramaturze min 55 g/m². Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 104 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 145 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro w obszarze krytycznym serwet (zgodnie z EN 13938-1) powyżej wymagań SWZ. Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 350 %, tj. min. 365 ml/m². Na etykiecie głównej 2 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

PAKIET 3

6. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie



Zestaw do artroskopii IV	
Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta nieprzylepna	150 x 190
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245
1 osłona na kończyne	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33






Obłożenia pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 49 g/m². Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

7. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:



Zestaw do zabiegów na kończynie VI extra wzmocniony (pad chłonny z wiskozy)	
Skład zestawu:	
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 x serweta dodatkowa wzmocniona	150 x 190
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 x serweta do operacji kończyny dolnej z otworem 5 x 7 cm z padem chłonnym z wiskozy. Wbudowany uchwyt Velcro	320 x 225
1 x osłona na kończynę	35 x 80
2 x taśma przylepna	10 x 50
4 x ręcznik celulozowy	30 x 33

Obłożenia pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 49 g/m². Wokół pola operacyjnego łąta chłonna z wiskozy o wymiarach 75 cm x 130 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 124 g/m².

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

8. **Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu pionowego izolacyjnego, który posiada w swoim składzie 2 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 cm x 33 cm, natomiast serweta izolacyjna foliowa, przezroczysta jest w rozmiarze 234 cm x 320 cm, z otworem 70 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia. Obłożenie pacjenta wykonane z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 70 µm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

ODP.: Zgodnie z SWZ.

9. **PAKIET 4, Poz. nr 1 i 2 oraz PAKIET 13, Poz. nr 3** - czy ze względu na krótki czas między ogłoszeniem przetargu, a otwarciem ofert Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia próbek niesterylnych, gdyż proces sterylizacji zestawów zmodyfikowanych na potrzeby danego postępowania trwa od 2 do 3 tygodni.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 5

10. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 150 cm lub w rozmiarze 95cm x 120 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 10

11. **Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 75 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 75 cm





- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 33 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 49 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 104 g/m².

W serwetach brak organizatorów przewodów.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej, folia PE o gramaturze min. 35 g/m²

oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min. 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - min.

63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE, 60 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze aqua, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Opakowanie jednostkowe z 2 samoprzylepnymi etykietami do archiwizacji zaw. nazwę producenta, nr serii, datę przydatności i nr katalogowy

ODP.: Zgodnie z SWZ.

**DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach**

Danuta Kowalewska

