

Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.11.2024

Pruszków, dnia **12.06.2024** roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Zakup i dostawa wyrobów medycznych wszczepialnych.**”

Odpowiedź na pytania w sprawie SWZ nr 2

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), – zwanej dalej „ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Treść pytania nr 1:

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kary umownej za przekroczenie obowiązującego terminu wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub terminu usunięcia usterki - w wysokości 2% wartości brutto wadliwego produktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za które odpowiada Wykonawca, jednak nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł za każdy dzień zwłoki? Ważnym jest aby kara umowna była adekwatna bo przewinienia.

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na złagodzenie kar umownych na:

-§ 11 pkt. 1 ust 1) zwłoki w dostawie zamówienia - w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie mniejszej niż 20,00 zł;

--§ 11 pkt. 4 Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi **15%** maksymalnej wartości przedmiotu Umowy brutto, wskazanej w § 3 ust. 1.?

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:


-§ 3 pkt. 10: 10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w okresie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 6-9, wynosi łącznie 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w ust. 1.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Treść pytania nr 2:

pyt. 1 . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2?

Siatkę do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową wykonany z polipropylenu monofilamentowego o całkowitej długości ok. 180mm, szerokości ramion ok. 25mm (+/- 0,5mm). Dolne ramiona zaokrąglone. Górne ramiona ścięte na długości 25mm pod kątem 45 stopni. Implant widoczny w badaniu MRI, RTG, USG.

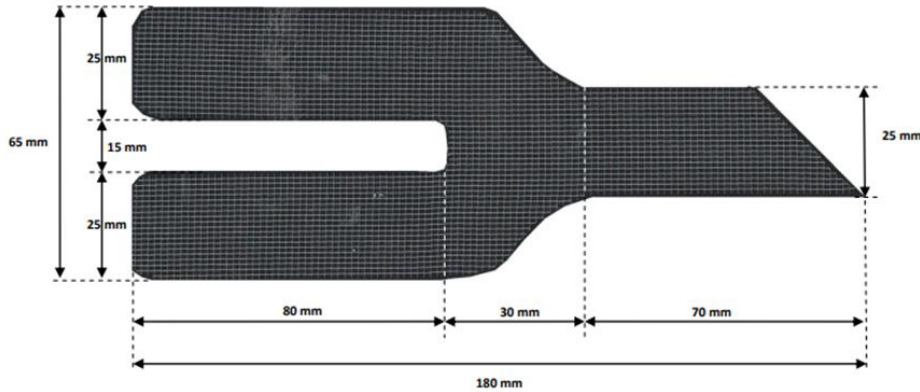


W przypadku dopuszczenia cena będzie oscylowała ok. 500 zł netto/1 szt

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 3:

pyt. 2 . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3?

Jednorazowy, sterylny system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in - out oraz out - in. Parametry : system całkowicie jednorazowy, sterylny. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniająca taśma; długość -450mm, szerokość -11mm (+/-1mm), grubość - 0,34mm, gramatura -45g/m², rozmiar porów – 1x1,25mm, rozmiar włókna (średnica) - 0,15mm. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej (dwuczęściowej osłonce)- minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji. Możliwość implantacji z dostępu przez otwory zasłonowe metodą in-out oraz out-in. W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty bezpłatnie użyczymy dwa wielorazowe narzędzia z wysokiej jakości stali chirurgicznej do implantacji (na czas trwania umowy przetargowej).

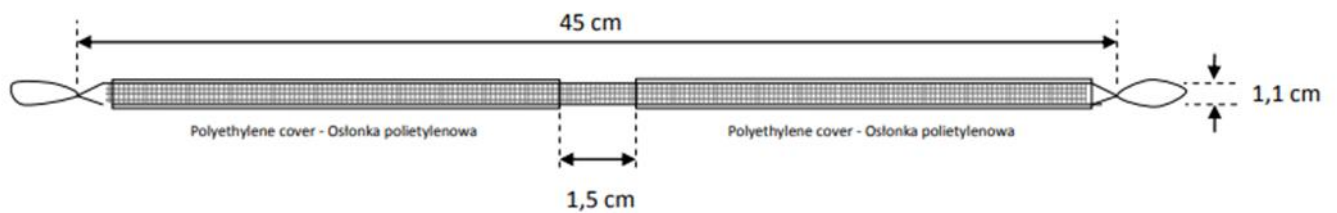

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 4:

pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6?

Siatkę ginekologiczną 45 g/m², wytwarzaną techniką dziewiarską ze 100% przędzy monofilamentowej polipropylenowej w kolorze transparentnym, dwuramienna. Na końcach każdego ramienia znajdują się wypustki, pozwalające na bezpieczne zamocowanie siatki w uchu aplikatora, służącym do przeprowadzenia implantu przez struktury anatomiczne i umiejscowienia w ciele pacjentki. Długość

ramienia z wypustką 32 cm. Wielkość porów 1,56 mm², porowatość na poziomie 55-60%. Opakowanie jednostkowe (koperta) zawiera 1 sztukę wyrobu, zapakowanego w podwójny rękaw papier-folia z etykietą i dołączoną instrukcją użytkowania.

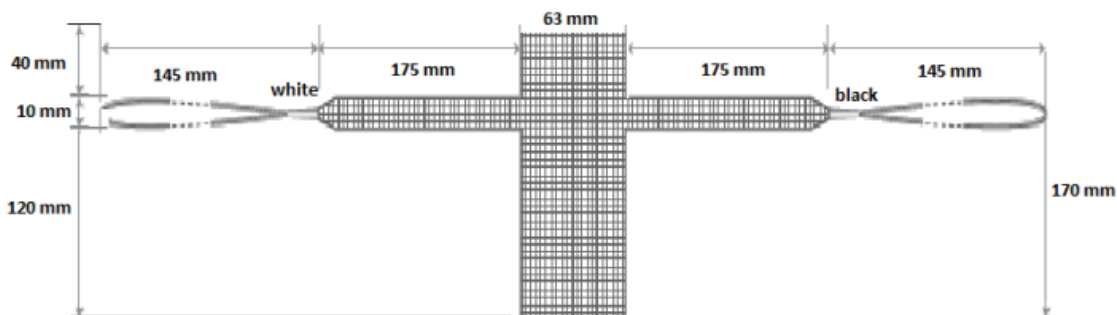


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 5:

pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7?

Poz. 1,2,3 - TVT - System załonowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, system całkowicie jednorazowy. Skład zestawu wchodzi taśma monofilamentowa wykonana z polipropylenu o dużej porowatości (1500-1950 μm), grubość taśmy 0,34mm, taśma cięta laserowo, szerokość; 1.1cm długość 45 cm, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty bezpłatnie użyczymy cztery wielorazowe narzędzia z wysokiej jakości stali chirurgicznej do implantacji (na czas trwania umowy przetargowej).

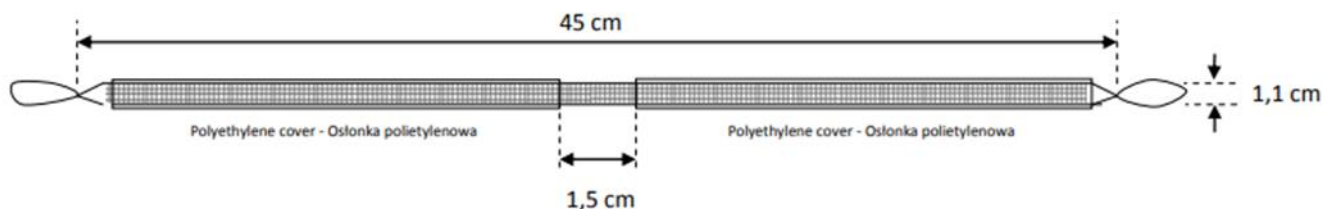

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.


Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 6:

pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8?

Poz. 1,2,3 - System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie, gramatura siatki 45g/m², porowatość siatki 55-60%, siatka z możliwością fiksacji kompartamentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgniętego lub powięzi zasłonowych, system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy.

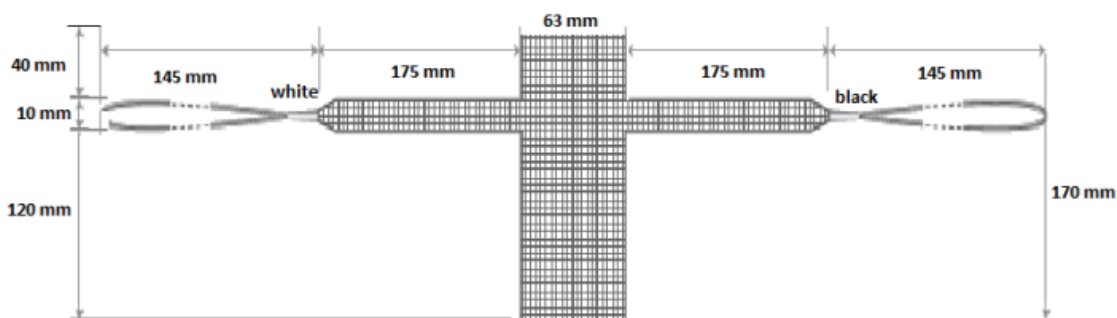

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 7:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 :

Pakiet nr 3- Taśma do nietrzymania moczu

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) która zapewnia optymalną wytrzymałość we wszystkich kierunkach oraz zapobiega deformacji i zwijaniu się taśmy ?

oraz komplet igieł spiralnych prawa lewa wielorazowego użytku do implantacji przez otwory zasłonięte?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 8:

2 .Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 7

Pakiet nr 7 System załonowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) która zapewnia optymalną wytrzymałość we wszystkich kierunkach oraz zapobiega deformacji i zwijaniu się taśmy **oraz igłę wielorazowego użytku służącą do implantacji załonowej ?**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.