



DZP/242/IM/2024

Tychy, 26.04.2024r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne pn. :

***Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitala Megrez Sp. z o. o.
Nr postępowania: 3/24/ZP/PN***

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 14. Stojak na kroplówki – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak na kroplówki, którego podstawa wykonana jest z tworzywa sztucznego, kolumna oraz statyw z aluminium, oraz głowica z 4 hakami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 14. Stojak na kroplówki – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak na kroplówki, którego wysokość regulowana jest w zakresie: od 104 do 211cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 14. Stojak na kroplówki – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stojak na kroplówki, którego podstawa ma średnicę 56cm?

Poniżej zdjęcie poglądowe stojaka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 132 867 750,00 zł





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 10. Pozycja 2. Mata do przenoszenia pacjenta – 2szt. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości matę do przenoszenia pacjentów wyposażoną w 6 uchwytów, o dopuszczalnym obciążeniu do 200kg, z możliwością mycia i dezynfekcji w temperaturze do 60oC, o wymiarach:

- długość: 150cm
- szerokość: 53cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 10. Pozycja 2. Mata do przenoszenia pacjenta – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości matę do przenoszenia pacjentów o wymiarach:

- długość: 2200mm
- szerokość: 1400mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie BEZPRZEWODOWEJ lampy LED najwyższej światowej jakości od lidera **ultralekkich rozwiązań czołowych/producenta z USA** o poniższych parametrach:



- Temperatura barwy: 4500 ° K
 - **CRI – Color Rendering Index – 75**
 - **Żywotność źródła światła: > 50.000 godzin**
 - Specjalnie zaprojektowany lekki czepek z podporą z tyłu czaszki „RCS” (Rear Cranial Support) zwiększająca komfort pracy
 - **Możliwość regulacji plamki światła 20-110mm z odległości 40cm**
 - **Waga czepek wraz z bateriami – 437grams**
 - **Waga baterii – 106g**
- Płynna regulacja intensywności natężenia światła na opasce czołowej : **0 - 30.000 lux z odległości 40cm, gdzie 30.000lux właśnie przy dystansie 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy;**

- Widoczny wskaźnik naładowania baterii z boku czepek – łatwa wymiana baterii podczas zabiegu
 - Żywotność baterii – 4h pracy przy maksymalnej intensywności światła – dwukrotnie większy czas żywotności przy 50% intensywności światła
 - Czas pełnego ładowania baterii – 4-5h
 - **Gwarancja producenta – 2 lata na czepek i 1 rok na baterie**

W skład zestawu wchodzi:

- RCS
- Lampa LED z opaską czołową i specjalnie zaprojektowaną podporą z tyłu czaszki
 - Akumulator na baterie oraz tłumik – zamontowane na czepecu
 - 2 baterie
 - Jednostanowiskowa ładowarka
 - Torba do przenoszenia z paskiem na ramię
 - Jednorazowe joysticki do pozycjonowania źródła światła

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. pakietu 12 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krzesła do masażu, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium o grubości 2 mm, w podgłówniku tapicerka ma grubość 8 cm, zakres regulacji kąta pochylenia podgłównika wynosi - 45° do 80°, siedzisko ma wymiary: 29x24x5 cm, podgłównik ma wymiary: 28x28x8 cm ? (foto proponowanego krzesła w załączeniu)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. pakietu 14 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaków do kroplówek ze stali

nierdzewnej z regulacją wysokości w zakresie 128 do 223 cm, oraz średnicą podstawy 46 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Pakiet nr 3 – Lampy bezcieniowe

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie! wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, nie wyraża zgody na wysyłkę sprzętu firmą kurierską.

pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę o zakresie ruchowości 50 stopni w górę oraz 48 stopni w dół? Rozwiązanie szersze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 21,5 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Okrągły kształt pozwoli uniknąć możliwości zranienia operatora o ostre krawędzie lampy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści lampę z bezdotykowa płynną regulacją natężenia światła, bez dedykowanego panelu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę o natężeniu 70 000 lux +/- 5%? Rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 96? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na R13 – 96 +/- 3? Jest to standardowa wartość w lampach zabiegowych tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

pkt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z głębokością oświetlenia 870 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm - w tym zakresie pełna iluminacja światła. Rozwiązanie korzystniejsze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

pkt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę o zużyciu 112 VA?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę o zużyciu 50 W?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy wynoszącą 21,5 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8

Pakiet nr 13 Elektroniczna waga platformowa dla pacjentów

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, nie wyraża zgody na wysyłkę sprzętu firmą kurierską.

pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści wagę :

-Wygodna do transportu za pomocą dodatkowych 4 kółek podgumowanych i wbudowane uchwyty.

-Wygodne ważenie także na krześle dzięki wyjątkowo dużej platformie oraz funkcji Pre-TARA

-Nośność 300 kg.

-2 samo stałe rampy podjazdowe do wygodnego wjazdu na wagę w pakiecie.

-Boczne barierki boczne zabezpieczające przed zsunieniem się łóżka.

-Łatwy odczyt wyników ważenia na wyświetlaczu przewodowym z podstawką na biurko lub mocowaniem do ściany.

-Wyświetlanie wyników z funkcją HOLD pozwala najpierw zająć się pacjentem, a dopiero w drugiej kolejności zanotować wynik ważenia.

-Pamięć 5 x pre-tara

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

pkt. 3/4 Czy Zamawiający dopuści wagę o nośności 300kg z podziałką 100g w całym zakresie?

Rozwiązanie korzystniejsze ze względu na brak konieczności przełączania zakresów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach wyświetlacza 210 x 45 x 110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach 800 x 66 x 1150 mm? Taka długość wystarczy, aby wygodnie korzystać z niej przy ważeniu pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści wagę o temperaturze pracy 0 do 40 stopni C? Rozwiązanie lepsze od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści wagę o wysokości cyfr 19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej 28,6 kg? Niższa masa zapewnia większą

mobilność wagi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Pakiet 6

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie poduszki pozycjonującej, wypełnienie 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe o wymiarach 50x85 cm. Możliwość prania poduszki wewnętrznej i pokrowca w temp. 95 stopni C.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie poduszki pozycjonującej, wypełnienie 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe o wymiarach 50x100cm. Możliwość prania poduszki wewnętrznej i pokrowca w temp. 95 stopni C.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz.3 Prosimy o dopuszczenie poduszki pozycjonującej, wypełnienie 50% pianka, 50% z włókna poliestrowe o wymiarach 50x60cm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

lub prosimy o dopuszczenie poduszki półokrągłej fi. 38 cm lub 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej o wymiarach 47x28x28cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie wałka pozycjonującego o wymiarach 225x20cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie wałka o wymiarach 20x80cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie poduszki odwodzącej o wymiarach 35x55cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9


Pakiet 7

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera RTG nogi, "pius" dla dorosłych, wykonanego z pianki PU z powłoką PU, o wymiarach 67x27x13cm.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie pozycjonera RTG głowy w pozycji na wznak, prosty dla dorosłych, wykonanego z pianki PU z powłoką PU, o wymiarach 25x24,5x9,5cm.

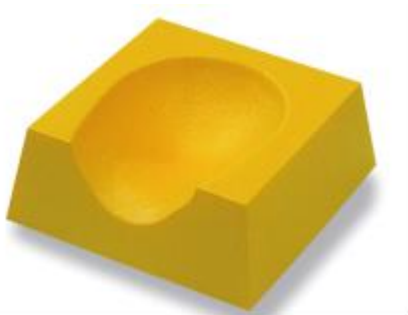

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pakiet 10

Poz. 1

prosimy o dopuszczenie prania w temp. 40OC

prosimy o odstąpienie od wymogu podawania nośności, gdy producent nie specyfikuje tego parametru

prosimy o dopuszczenie 2 taśm do mocowania i 7 uchwytów do korygowania pozycji pacjenta





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maty do przesuwania pacjenta o nośności do 160 kg.

Prosimy o dopuszczenie prania w temp 60OC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie wymiarów 200x90cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie wymiarów 76x36 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

Sporządziła
Ineta Młynarska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych