

numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Wejherowo, dnia 12.04.2019 r.

D.25C/250/208/2019

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. 10 pkt 11 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DO LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/11-19rj/19, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 20 poz. 1 poniższej konfiguracji zestawów typu Abbott jak dotychczas stosowanych przez Zamawiającego:

Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 150 cm + kranik + 15 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię; linie przezroczyste aby był dobrze widoczny przepływ. Bezzpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne koreczki. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet.

Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie NR 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o długości 25 cm ? Lub też tolerancję długości do 1,5 cm ? pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie NR 3


Czy Zamawiający ma na myśli haczyk do naktłcia worka płodowego jak na zdjęciu ?




Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Sycylijskiego 1, 81-519 Odynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11. + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492701 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 72 84 770 | REGON 190 14 16 17 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

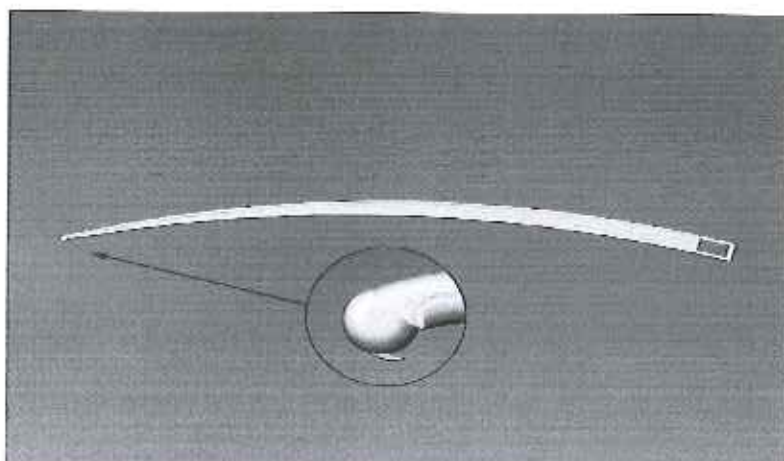

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zapisów SIWZ rozdz. XVII pkt 4, Formularz ofertowy pkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin będzie wynosi 2 dni a maksymalny 4 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu min. 1 dnia (a nawet krócej, gdyż nie ma określonej dolnej granicy), nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z dotychczasowego wieloletniego doświadczenia Zamawiającego, który współpracuje z Wykonawcami z całej Polski, wynika iż termin określony w kryterium jest realny i nie preferuje Wykonawców z bliskiej okolicy. Zamawiający nie zmienia kryterium.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zapisów umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.





numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Dot. zapisów umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SIWZ, rozdział XVII ust. 6, pakiet nr 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku w pakiecie nr 14?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ceny jednostkowe mogą być podane do 4 miejsc po przecinku ale cena oferty musi być podana do 2 miejsc po przecinku.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, §3 ust.2

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z projektu umowy § 3 ust. 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, §3 ust.3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której Wykonawca wystawił fakturę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, §4 ust.1

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ust. 1 na:

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem lub pisemnego, złożonego przez pracownika Działu Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.


12. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, §4 ust.4

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ust. 4 na:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą - braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańców Syczeńskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ: w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000497201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

- wad jakościowych w ciągu 14 dni.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, §5 ust.1.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ust. 1 na:

„ Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednio zastosowanie ma § 8 ust. 4 niniejszej umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki Intubacyjnej Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny-pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 60 cm,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny-pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 36.5 cm,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 1

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Sycylińskich 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Ochońsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 150 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 32 ml i masie 23 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer – przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 33 mgH₂O przy Vt=500 ml, przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH₂O przy Vt=50 ml, waga 9 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr dziecięcy, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H₂O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samodomykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, walidowany w kierunku Tbc, WZW i HIV, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Pawłanta Styczniewego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 77 60 119; fax +48 58 77 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11. + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynawahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492701 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/11-19r/19

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, walidowany w kierunku Tbc, WZW i HIV, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince typu Luer?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 20 – Przetwornik do pomiaru IBP

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available

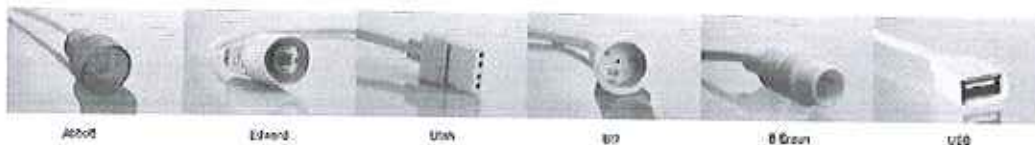

Odpowiedź Zamawiającego:

Końcówka BBraun

24. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 20 – Przetwornik do pomiaru IBP

Dłuższy lub krótszy dren ciśnieniowy nie wpływa w żaden sposób na dokładność działania przetwornika. Czy Zamawiający dopuści długość 1 x drenu ciśnieniowego 120 cm lub 130 cm oraz 1 x 20 cm lub 30 cm? Tak aby zachować długość całej linii ciśnieniowej ok. 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający oczekuje cewnika, który jest anatomicznie wygięty, co umożliwi jego właściwe i bezpieczne stosowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3

Czy zam. dopuści cewnik o długości 25 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

27. Zapytanie Wykonawcy:


Zapytania dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Ślęczyńskiego 1, 81-519 Cdynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200, +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretaria@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

28. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby dostawy odbywały się do godz. 15:00? (dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci o nieznacznie większej przestrzeni martwej 36 ml oraz niższej wadze 19 g. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

31. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9998 % oraz przestrzeni martwej 51 ml. Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Filtr ten jest obecnie stosowany innej lokalizacji Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

32. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego, elektrostatycznego, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, poziomie nawilżania 28 mg H₂O przy Vt=50ml oraz niższej wadze 9 g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Filtr ten jest obecnie stosowany innej lokalizacji Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańców Styczniowych 1, 81-519 Gdynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200 ; +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Grkańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 000049220 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

33. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dzieleńczego, elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, p/wirusowej 99,99%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Filtr ten jest obecnie stosowany innej lokalizacji Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

34. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennikiem o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, z manualnie domykanym portem do odsysania pomiędzy jedną celulozową membraną wymiennika, przeznaczony dla pacjentów o masie powyżej 15 kg, sterylne.

Filtr ten jest obecnie stosowany innej lokalizacji Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

35. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia filtra mechanicznego, z obecnie najwyższą skutecznością filtracji, z plisowaną membraną hydrofobową o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999999%, p/wirusowej 99,999999%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeni martwej 95 ml, wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wadze 53 g, wydajności nawilżania 34,1 mg/l przy Vt=500 ml, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

36. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 13, Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa: 66 ml, opór przepływu 1,9 cm H₂O przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 39 g, filtr ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno, złącze 22M/15F – 22F/15M.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza


37. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999% bez wymiennika ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 39,64ml ze złączem prostym, portem kapno z korkiem luer-lock, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

38. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 37mg H₂O przy Vt-500ml, ze złączem prostym, portem kapno z korkiem luer-lock, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

39. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Poprosimy o dopuszczenie w pozycji 3 wymiennika ciepła i wilgoci dla noworodków o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,99999% dla zakresu objętości 15-50ml, nawilżaniu min 30mg H₂O przy Vt20ml, wadze 2,4g, z łącznikiem standardowym, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

40. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 filtra dziecięcego elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,99%, pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, ze złączem prostym, portem kapno z korkiem, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

41. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 filtra mechanicznego, klasy HEPA 13, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,99999%, z pozostałymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego z portem kapno z korkiem luer-lock, złączem prostym, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

42. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 13

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 filtra mechanicznego, klasy HEPA 13 o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,99999%, z pozostałymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego z portem kapno z korkiem luer-lock, złączem prostym, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza

43. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.


numer sprawy: D25C/251/N/11-19r/19

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej o parametrach:

- rozkładana trzyczęściowa konstrukcja
- wyposażona w piankę w części górnej
- dzięki zastosowanej konstrukcji maska szczelnie przylega do każdego kształtu twarzy
- wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos
- wyposażona w zawór wydechowy najnowszej generacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie
- mocowana na gumki
- duża powierzchnia filtra zapewnia doskonały rozkład cząsteczek, a tym samym oferuje najwyższy komfort noszenia nawet podczas długiego czasu użytkowania
- **możliwość użytkowania podczas pracy z cytostatykami**
- wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania najwyższego poziomu ochrony FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
- kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC
- pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym
- pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją
- graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
- maska w kolorze żółtym, gumki mocujące w kolorze niebieskim
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

45. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ceny jednostkowe mogą być podane do 4 miejsc po przecinku ale cena oferty musi być podana do 2 miejsc po przecinku.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Syczeńskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax + 48 58 72 60 337
Dział Zamówień Publicznych w lokalności: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax + 48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000497201 | kapitał zakładowy: 164 400 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Kryterium nr II: Termin dostawy pkt. XVII SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla zadania nr.1 na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni robocze ?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 5%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyższej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 24 godziny otrzyma 5 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy tj. 2 dni rob. - tylko 2,5 pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: *"Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzają do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.*

Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy 2 dni robocze.


Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem przetargu nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 ; + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11,+ 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 17 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Z dotychczasowego wieloletniego doświadczenia Zamawiającego, który współpracuje z Wykonawcami z całej Polski, wynika iż termin określony w kryterium jest realny i nie preferuje Wykonawców z bliskiej okolicy. Zamawiający nie zmienia kryterium.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie (...), przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust. 4)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Projektu umowy:

Dotyczy § 7 ust.1 pkt 1

Prosimy o zmian zapisu na " Zmiana nastąpi automatycznie z dniem wejścia przepisów w życie, bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu 13 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, z portem kapno, przestrzeń martwa 42ml, opór 2,2cm, waga 23g, z portem kapno zamykanym koreczkiem


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

51. Zapytanie Wykonawcy:


dotyczy pakietu 13 Pozycja 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańców Stycznińskich 1, 81-519 Cdynia | tel. + 48 58 72 40 119; fax +48 58 72 40 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 460 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A, nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 57ml, opór 2,7cm, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H₂O/L z portem kapno zamykanym koreczkiem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

52. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 13 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy noworodkowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór 1,1cm H₂O przy 11L/min., waga 11g, skuteczność nawilżania 27mg H₂O/L przy VT 25ml z portem kapno zamykanym koreczkiem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

53. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 13 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28ml, opór 1,7cm H₂O przy 30L/min., waga 23g, skuteczność nawilżania 32mg H₂O/L przy VT 250ml z portem kapno zamykanym koreczkiem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

54. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 13 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie: Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego wymiennika z wkładem piankowym i standardowym zamknięciem portu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

55. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 13 Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie: Prosimy o dopuszczenie filtrów o skuteczności 99,99%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

56. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 13 Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie filtrów o skuteczności 99,99% z portem kapno zamykanym koreczkiem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

57. Zapytanie Wykonawcy:
dotyczy pakietu 16 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy do respiratora iVent 201 o długości 4m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.


58. Zapytanie Wykonawcy:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Sycylijskich 1, 81-519 Orłynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200, +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 400 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

dotyczy pakietu 20

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami tj. Mindray BeneView T8 – 8 szt., Mindray uMEC12 – 6 szt., Mindray iPM 12 – 4 szt.

59. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu 23

Prosimy o dopuszczenie 3 zestawów do higieny jamy ustnej do procedury co 8 godzin pakowanych w zbiorcze opakowanie na 24 z uchwytem do odwieszenia – w skład każdego zestawu wchodzi saszetka z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz pojemnik i gąbki do pędzlowania, w skład jednego szczoteczka z regulacją siły odsysania a w skład 2-aplikatorowy przyrząd do czyszczenia/pędzlowania zębów i jamy ustnej z możliwością odsysania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

60. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy pakietu 23 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie i uznanie za równoważne zestawu miękkich aplikatorów z tworzywa sztucznego z regulacją odsysania oraz żelu do higieny jamy ustnej – pakowanych indywidualnie 2 aplikatorów i jednego żelu do higieny jamy ustnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

61. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H₂O (4 psi) z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

62. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z kontrolą ssania o długości max 600mm.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpitalwejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 1 64 480 000,00 zł



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Pakiet 10 Poz. 1

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przezroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip? Nadmieniamy, iż tego rodzaju kontrola ssania eliminuje całkowicie zjawisko podkradania powietrza z płuc pacjenta w trakcie wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max. wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj. w trakcie wycofywania cewnika.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

65. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki i kontrolą ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

66. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają być pakowane prosto, nie zwijane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż cewniki mają być pakowane prosto.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego w rozmiarach od CH 8 do CH 34.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

68. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego w rozmiarach od CH 8 do CH 36.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do karmienia w rozmiarach od Ch4 do Ch 10

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

70. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do karmienia o długości 40 cm.


Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Sycylińskich 1, 81-519 Gdynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200, +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sędz Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Zamawiający nie dopuszcza

71. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 3000 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

72. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu o dł. 210 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

73. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 5000 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

74. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu o dł. 420 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

75. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 4, 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane cewniki do podawania tlenu mają być wolne od DEHP oraz wyposażone w łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego co zniweluje potrzebę używania dodatkowych adapterów typu DISS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z osobno pakowanym workiem w kolorze zielonym o wymiarach 200x300mm. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6 do odrębnego pakietu.

77. Zapytanie Wykonawcy:


Pakiet 11 Poz. 1, 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańca Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Odańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w opakowaniu folia – papier, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w opakowaniu folia – papier, sterylizowanych tlenkiem etylenu, o pojemności balonu 30 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli cewniki Tiemana?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie przedmiotu zamówienia doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Zgodnie z opisem dla poz. 5 zawartym w tabeli Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika Tiemana.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy maski filtrującej jednorazowego użytku, bez zaworu wydechowego, ale o bardzo małych oporach (przy wdechu <0,65 mbar i wydechu <0,99 mbar). Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych) lub równoważnymi. Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009 lub równoważnych. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej $\geq 99\%$ oraz odporność na rozpryski ≥ 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Maska jednopanelowa wykonana z przyjemnego materiału typu Spunbond, z profilowaną częścią nosową, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Mocowana na poprzeczne gumki. Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz przy wilgotności względnej do 80%. Pakowana indywidualnie w opakowania zbiorcze po 10szt. Możliwość użytkowania maski do 8 godzin pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańców Styczniowych 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax + 48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax + 48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Zamawiający nie dopuszcza

83. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej min. 99,99%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 35 ml, waga 16g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

84. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9999\%$, p/wirusowej $\geq 99,99\%$, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 36 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

85. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9998\%$, p/wirusowej $\geq 99,99\%$, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mgH₂O przy Vt =500 ml, przestrzeń martwa 51 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

86. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy filtr powinien charakteryzować się skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie $\geq 97,416\%$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

87. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza

88. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańców Sycylińskich 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

89. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego, elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,999\%$, p/wirusowej $\geq 99,99\%$, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O przy Vt=250ml, waga 21 g, objętość oddechowa Vt 75-300 ml filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

90. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

91. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, jendomembranowy, przeznaczony od objętości oddechowej Vt > 50 ml, sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

92. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9999\%$, p/wirusowej $\geq 99,9999\%$, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa 96 ml, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H₂O przy VT=500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

93. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy filtr powinien charakteryzować się skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie $\geq 99,764\%$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

94. Zapytanie Wykonawcy:


Pakiet 13 Poz. 7

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańca Słycznikowego 1, 81-619 Gdynia | tel: +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagońskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200, +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl;
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 14 40 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, p/wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa: 35 ml, opory przepływu 3,6 cm H₂O przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, złącze 22F-15M/15F-22M

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

95. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G 2 3/4" 70mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

96. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G 2" 50mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

97. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 poz. 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G 4 3/4" 120mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

98. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaofierowania igły 22G x 0,7" długości 130mm, spełniającej pozostałe wymogi siwz. Różnica 3mm w stosunku do pierwotnie wymaganej długości jest niezauważalna dla użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

99. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaofierowania igły w rozmiarze 18G/ 1,2 x 150mm, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

100. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaofierowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatraskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

101. Zapytanie Wykonawcy:


Pakiet 15



Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Stycznińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. +48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. +48 58 57 27 200, +48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, +48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 17 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożnego, wykonanego z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii - poliamidu. Posiadający trójramienne pokrętko umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. Kranik z mechanizmem umożliwiającym zmianę pozycji kranika po podłączeniu do systemu bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 16 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego o dł. 6m kompatybilnego ze środowiskiem MRI.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

103. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego: 3 szczoteczki do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 3 jednorazowe opakowania 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny, 3 gąbki-aplikatory do pędzlowania jamy ustnej, 3 saszetki z 2 g preparatem nawilżającym do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E – zestaw umożliwiający wykonanie 3 pełnych procedur w ciągu doby

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

104. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

105. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 23 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu do toalety jamy ustnej ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania dzięki wyciskającym saszetkom typu 'burst pouch' ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

106. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 23 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1% ?


Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Pawłonia Śtyczkiewicza 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 319; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000497201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/11-19rj/19

Zamawiający nie dopuszcza

107. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 23 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, gąbkę z możliwością odsysania - będące inwazyjnymi wyrobami medycznymi stosowanymi przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem

**STARBSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych**



Marzena Magula

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.



ul. Powstańców Syczeńskiego 1, 81-519 Cdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl | www.szpital.wejherowo.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 164 480 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu