



INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania. pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, grubość na palcu $0,18\text{mm} \pm 0,02$, na dłoni $0,16\text{mm} \pm 0,02$, mankiecie $0,14\text{mm} \pm 0,02$, długość min 280 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,21\text{mm} (+/-0,02)$, dłoni $0,18\text{mm} (+/-0,01)$, mankiecie $0,17\text{mm} (+/-0,01)$, długość min. 280mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością pojedynczej ścianki na palcu $0,18\text{mm} (+/-0,03)$, dłoni min $0,10\text{mm}$, mankiecie min. $0,10\text{mm}$ i o długości min. 280mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6.0-8.5?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy, grubość ścianki na palcu $0,33 \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,27 \pm 0,02\text{mm}$, na mankiecie $0,22 \pm 0,01\text{mm}$, długość min 278mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpydrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwie antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu $0,17 \pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,15 \pm 0,02\text{mm}$, na mankiecie $0,13 \pm 0,02\text{mm}$, długość min 278mm, poziom protein lateksowych poniżej $35\mu\text{g/g}$, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 15N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, nie starszymi niż 2016 r. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455-1 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2,4,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek



ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-8.5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpydrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: $0,20 \pm 0,02$, dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm, mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III typ A– potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18 \pm 0,02$, na dłoni $0,16 \pm 0,02$, mankiecie $0,14 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 $\mu\text{g/g}$, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dispenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm³ co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem GS-128?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpydrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2, EN 16523. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpydrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III typ A – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź:

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m² w kolorze niebieskim, wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 42 g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze od M do XXL, długość fartucha (+/- 3 cm) dla rozmiaru M -120 cm, dla L -130 cm, dla XL -150 cm, dla XXL -170 cm, oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny który posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier wyposażony w informację o kierunku otwierania raz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany w okolicy karku na standardowy rzep, oraz wiązany na troki w okolicy pasa?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.


Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność warstwy zewnętrznej 304% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

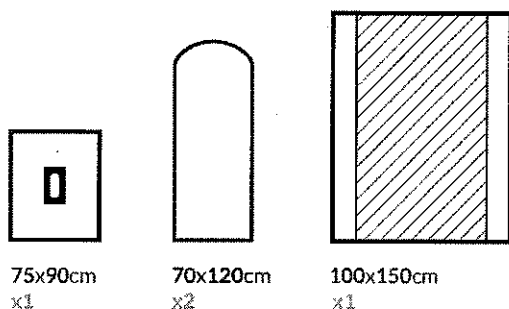

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści sterylizowany zestaw do zabiegów cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.


Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

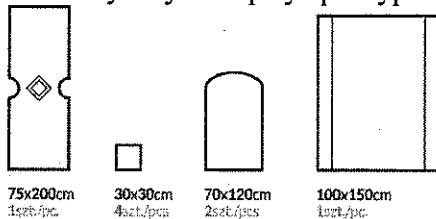

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm



- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 478% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z dzianiny, reszta zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą typu TAG z dwoma naklejkami służącymi do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestaw do żywienia p/jelitowego był sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentarium wym. 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony na rękawach i przedniej części laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 40g/m² z mankietem o dł. 7,5cm. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O, rzep w okolicy szyi o długości prawy 13cm, lewy 7cm. Długość fartucha 140cm (+/- 3cm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę 75cm x 90cm, wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m² (PP +PE+SPP), wzmocniona w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę prostokątną 90cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.





Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wym. 235cm x 340cm z dwoma samoprzylepnymi otworami w okolicy tętnic udowych o śr. 8cm oraz dwoma samoprzylepnymi otworami w okolicy tętnicy promieniowej o wym. 7cm x 12cm. Serweta z dodatkową warstwą chłonną o wym. 150cm x 120cm, zintegrowana z dwoma przezroczystymi panelami (folia PE) o szer. 67,5cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² wzmocniona włókniną trójwarstwową gramaturze 106g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści etykietę typu TAG z 4 naklejkami umieszczoną wewnątrz opakowania w widocznym miejscu wykonanego z przezroczystej folii ze wstawką Tyvek?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na



rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy AAMI PB70 poziom 3, ponieważ jest to norma amerykańska?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm



- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze całkowitej 77g/m², warstwy serwety zgrzewane na gorąco o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści ręcznik o wym. 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o wym. 80x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o wym. 90x100cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 114x150cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów wykonanym z transparentnej folii PE 0.08mm, rozmiar torby 78x80cm o poj. 2500ml, wyposażona w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej i port do odsysania treści w dolnej części worka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 113x90cm w kształcie różka z sztywnikiem wykonaną z dwuwarstwowego laminatu bez dodatkowych taśm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy AAMI PB70 poziom 3, ponieważ jest to norma amerykańska?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m². Łączenia wykonane techniką ultradźwiękową?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'20?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 1-13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dyspensera?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m². Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną dodatkową taśmę samoprzylepną?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'100?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiającą umocowanie kieszeni. Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. W rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'180?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 4-7, 9,10, 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wytrzymałością na wypychanie na mokro 99 kPa, na sucho 100 kPa, Chłonność serwety: 600%?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90cm x 120cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10cm x 50cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 56 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'1100?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 57 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 58 – dotyczy pakietu nr 1 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'120?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 59 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50cm x 60cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 60 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Ośłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 61 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści:

Serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w dwa sztywniki do formowania serwetki na głowie

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 62 – dotyczy pakietu nr 25, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120cm x 150cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

REFERENCJA

ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak



**DOLNY
ŚLĄSK**