

KPIM/834/2020
DZP.38.5.2020.MK

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku i Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” – ZP/05/20.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi pytaniami udzielamy wyjaśnień:

Dotyczy: Pakiet nr 5 łóżko szpitalne do rehabilitacji neurologicznej z przechyłami bocznymi wraz z szafkami przyłóżkowymi – 6 kpl.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowitą 2270 mm, szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm oraz wymiary leża pod materac 850 x 2000 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści dwa wskaźniki kąta nachylenia tj. segmentu pleców oraz przechyłów wzdłużnych (Trendelenburga i anty-Trendelenburga)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości; wysokość barierek bocznych min. 40 cm, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52:2010?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe wypełnione w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia odejmowanymi płytami HPL (segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo); segment oparcia pleców przezierny dla RTG wraz z przewodnikami i tacą na kasetę RTG?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


6. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści regulację elektryczną segmentu oparcia pleców 0° – 65°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści regulację elektryczną segmentu uda 0° – 47° ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści regulację elektryczną przechyłów bocznych leża ok. 20° ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
9. Czy (w pkt. 14 i 15) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dźwignię CPR umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu - funkcja wyrównująca segment oparcia pleców oraz elektryczną funkcję CPR dostępną z jednego przycisku znajdującym się na panelu centralnym umożliwiającą uzyskania pozycji reanimacyjnej (segmenty leża poziomują się, a leże obniża się do minimalnej wysokości)?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
10. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne przy pomocy:
– Pilota przewodowego, czytelnego i wygodnego w obsłudze dla pacjenta
– Dostępne funkcje z panelu centralnego: elektryczny CPR, pozycja szokowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna; informacja o zablokowanej funkcji leża (regulacji wysokości, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji przechyłów bocznych); panel centralny z możliwością podwieszenia pod półką na pościel oraz z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 500 mm do 900 mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
12. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści ochronę przed uderzaniem – 4 kółka odbojowe stożkowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
13. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści stalowe, lakierowane proszkowo szyny do akcesoriów po obu stronach łóżka wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
14. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści 4 koła jezdne, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe) o średnicy 15 cm z blokadą centralną i kierunkową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o poniższych parametrach:
- Korpus szafki wykonany z profili stalowych aluminiowych, boki korpusu z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego dwustronnie laminowanego tworzywa; czoła szuflad z możliwością wyboru koloru (9 kolorów do wyboru)
 - Boczne krawędzie blatu górnego zabezpieczone relingami ochronnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej zabezpieczający przed upadkiem
 - Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę, dostęp do półki od frontu szafki
 - Szuflada dolna wyposażona w wymowany tworzywowy wkład dzielący wnętrze szuflady na dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o poj. 1,5l
 - Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych umożliwiającymi ciche i łatwe wysuwanie oraz domykanie
 - Wymiary zewnętrzne:
 - wysokość 870 mm
 - szerokość szafki 440 mm
 - szerokość szafki z podporą blatu 570 mm
 - głębokość 445 mm
 - Czoła szuflad wyposażone w uchwyty do otwierania w kolorze stalowym
 - Pod dolną szufladą półka stalowa, lakierowana proszkowo na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), dostęp do półki tylko od frontu szafki
 - Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwością regulacji kąta pochylenia
 - Regulacja blatu bocznego w zakresie 750 – 1100 mm
 - Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL
 - Blat boczny z możliwością zamocowania po prawej lub lewej stronie szafki
 - Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne, w tym 2 z blokadą o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem; blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5-te koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków
 - Konstrukcja szafki przystosowywana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
 - Możliwość wyboru kolorów frontów szafki (9 kolorów do wyboru)



(Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Łóżko szpitalne do rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z szafkami przyłózkowymi – 34 kpl.

16. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wymiary leża pod materac 850 x 2000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 65° z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 15°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady podstawowych funkcji przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na centralnym panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); w celu bezpieczeństwa pacjenta pilot bez możliwości regulacji funkcji Trendelenburga (w oferowanym łóżku funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga będzie dostępna tylko na centralnym panelu sterowania przeznaczonym dla personelu); pilot bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci (sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka elektrycznego jest ono zawsze podłączone do sieci, a o konieczności odłączenia łóżka od sieci np. w przypadku jego przemieszczania informuje o tym stosowany zapis w instrukcji obsługi)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

24. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego, łatwo odejmowane; szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do łatwego transportu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

25. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe bariery boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości; wysokość barierek bocznych min. 40 cm, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52:2010?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

26. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko standardowo wyposażone w uchwyty na worki urologiczne po dwóch stronach leża?

Odpowiedź:


Tak, Zamawiający dopuszcza.

27. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści podstawę łóżka jezdną, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

28. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?

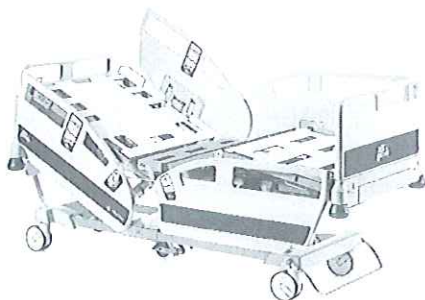

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową bez blatu bocznego (20 szt.) o poniższych parametrach:

- Korpus szafki wykonany z profili stalowych aluminiowych, boki korpusu z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego dwustronnie laminowanego tworzywa; czoła szuflad z możliwością wyboru koloru (9 kolorów do wyboru)
- Boczne krawędzie blatu górnego zabezpieczone relingami ochronnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej zabezpieczający przed upadkiem
- Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę, dostęp do półki od frontu szafki
- Szuflada dolna wyposażona w wyjmowany tworzywowy wkład dzielący wnętrze szuflady na dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o poj. 1,5l
- Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie oraz domykanie
- Wymiary zewnętrzne:
 - wysokość 870 mm
 - szerokość szafki 440 mm
 - głębokość 445 mm
- Czoła szuflad wyposażone w uchwyty do otwierania w kolorze stalowym
- Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne, w tym 2 z blokadą o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
- Konstrukcja szafki przystosowywana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
- Możliwość wyboru kolorów frontów szafki (9 kolorów do wyboru)



(Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki)


Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

30. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym (14 szt.) o poniższych parametrach:

- Korpus szafki wykonany z profili stalowych aluminiowych, boki korpusu z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego dwustronnie laminowanego tworzywa; czoła szuflad z możliwością wyboru koloru (9 kolorów do wyboru)
- Boczne krawędzie blatu górnego zabezpieczone relingami ochronnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej zabezpieczający przed upadkiem
- Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę, dostęp do półki od frontu szafki
- Szuflada dolna wyposażona w wyjmowany tworzywowy wkład dzielący wnętrze szuflady na dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o poj. 1,5l

- Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie oraz domykanie
- Wymiary zewnętrzne:
 - wysokość 870 mm
 - szerokość szafki 440 mm
 - szerokość szafki z podporą blatu 570 mm
 - głębokość 445 mm
- Czoła szuflad zaopatrzone wyposażone w uchwyty do otwierania w kolorze stalowym
- Pod dolną szufladą półka stalowa, lakierowana proszkowo na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), dostęp do półki tylko od frontu szafki
- Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwością regulacji kąta pochylenia
- Regulacja blatu bocznego w zakresie 750 – 1100 mm
- Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL
- Blat boczny z możliwością zamocowania po prawej lub lewej stronie szafki
- Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne, w tym 2 z blokadą o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem; blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5-te koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków
- Konstrukcja szafki przystosowywana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
- Możliwość wyboru kolorów frontów szafki (9 kolorów do wyboru)



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Łóżko szpitalne do rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z szafkami przyłóżkowymi – 34 kpl

31. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 8 tygodni ?

Odpowiedź:

Zamawiający 21.10.2020 r. zmodyfikował SIWZ.

32. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 1 długość całkowitą 2150 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 1 leże 850 x 2000 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

34. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 8 bez wskaźnika kąta przechyłu ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 11 pilota z blokadą selektywną wszystkich funkcji co w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 15 płytę HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

37. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 29 blat górny szafki wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym oraz czoła szuflad wykonane z blachy metalowej malowanej proszkowo ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 30 reling z boku szafki na ręcznik z blatem z zaokrąglonymi krawędziami zamiast aluminiowych listew bez uchwytu na kubek ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 31 szufladę i drzwiczki ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

40. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 32 prowadnice suwne ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 42 blat górny szafki wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym oraz czoła szuflad wykonane z blachy metalowej malowanej proszkowo ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

42. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 43 reling z boku szafki na ręcznik z blatem z zaokrąglonymi krawędziami zamiast aluminiowych listew bez uchwytu na kubek ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

43. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 44 szufladę i drzwiczki ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

44. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 45 prowadnice suwne ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 49 sprężynę gazową osłoniętą metalową owalną obudową ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

46. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 49 metalowe dźwignie do regulacji wysokości, które są zamontowane na wysokości pacjenta bez konieczności pochylania się ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

47. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 51 blat boczny z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

48. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 53 blat boczny montowany na stałe ale przy szafce dwustronnej z możliwością postawienia z lewej lub prawej strony bez konieczności przekładania ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 Łóżko szpitalne do rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z szafkami przyłóżkowymi – 34 kpl

49. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne o długości całkowitej 2110mm +/- 10mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

50. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne o szerokości leża 850mm +/- 10mm przy szerokości całkowitej 980mm +/-10mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne o szerokości leża 860mm przy szerokości całkowitej 990mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

52. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z segmentem pleców sterowanym elektrycznie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

53. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu uda w zakresie 0-40 stopni +/- 5 stopni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

54. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z regulacją elektryczną funkcji Trendelenburga w zakresie 0-17 stopni +/- 2 stopnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

55. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z regulacją elektryczną funkcji anty-Trendelenburga w zakresie 0-17 stopni +/- 2 stopnie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

56. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z regulacją elektryczną zmiany wysokości leża w zakresie 410-810mm +/- 10mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

57. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z regulacją elektryczną zmiany wysokości leża w zakresie 470-880mm +/- 10mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

58. Czy Zamawiający dopuści łóżka, w których czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 37 sekund?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

59. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne sterowane pilotem przewodowym bez sygnalizacji dźwiękowej aktywowanej każdorazowo przy zmianie pozycji leża, natomiast wyposażony w sygnalizację wzrokową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

60. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne, w którym segmenty leża wypełnione są płytą HPL nieodejmowaną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

61. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne w którym segmenty leża wypełnione są płytą HPL odejmowaną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

62. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne wykonane z profilu stalowego okrągłego, niespłaszczzonego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

63. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne wyposażone w szczyty, w których górna część szczytu nie jest wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu? Szczyty skonstruowane są w ten sposób, że w żaden sposób nie utrudniają transportu pacjenta na łóżku.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

64. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne wyposażone w barierki lakierowane proszkowo wykonane z profili okrągłych fi 25mm składane wzdłuż leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

65. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne wyposażone w barierki lakierowane proszkowo wykonane z profili okrągłych fi 25mm składane wzdłuż leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę EN 60601-2-52 zabezpieczające pacjenta na 75% długości jego ciała i wyposażone w dodatkowy protektor stalowy zabezpieczający pozostałe 25% ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne wyposażone metalowe uchwyty materacy umiejscowione w ten sposób, że zapobiegają urazom kończyn pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

67. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z podstawą jezdną łóżka wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

68. Czy Zamawiający dopuści łóżka elektryczne z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 6 kolorów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

69. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485 na oferowane produkty? Oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez nich w/w certyfikatu, w związku z powyższym wymaganie go w specyfikacji technicznej SIWZ-u wpływa na ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

70. Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów szczytów z 6 kolorów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

71. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe, w których korpus szafki wykonany jest z profili stalowych pokrytych lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

72. Czy Zamawiający dopuści szafki wykonane w całości (oprócz blatów szafki) wykonane są ze stali węglowej pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

73. Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w metalowy reling umiejscowiony na tylnej części blatu posiadający tworzywowy haczyk na ręczniki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

74. Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w metalowy reling umiejscowiony z boku szafki posiadający tworzywowy haczyk na ręczniki?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
75. Czy Zamawiający dopuści szafki niewyposażone w tworzywowy uchwyt na szklankę?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
76. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone są tworzywowymi wałkami?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
77. Czy Zamawiający dopuści szafki składające się z jednej szuflady i jednego kontenera podzielonego na pół wyjmowaną półką zamykanego drzwiczkami?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
78. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty szuflady i kontenera wykonane są ze stali węglowej pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
79. Czy Zamawiający dopuści szafki w których górna szuflada jest wyposażona w odejmowany, tworzywowy (polietylen) wkład dzielący szufladę na dwie części?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
80. Czy Zamawiający dopuści szafki, wyposażone w szufladę górną o wysokości 105mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
81. Czy Zamawiający dopuści szafki z dolny kontenerem zamykanym drzwiczkami z półką z płyty HPL dzielącą kontener na dwie części, półka z wcięciem na butelki stanowiącym uchwyt na butelki 1,5l, półka łatwo demontowana?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
82. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 800mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
83. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości 430mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
84. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm +/-10mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

85. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485 na oferowane produkty? Oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez nich w/w certyfikatu, w związku z powyższym wymaganie go w specyfikacji technicznej SIWZ-u wpływa na ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 14szt.

86. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe, w których korpus szafki wykonany jest z profili stalowych pokrytych lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

87. Czy Zamawiający dopuści szafki wykonane w całości (oprócz blatów szafki) wykonane są ze stali węglowej pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

88. Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w metalowy reling umiejscowiony na tylnej części blatu posiadający tworzywowy haczyk na ręczniki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

89. Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w metalowy reling umiejscowiony z boku szafki posiadający tworzywowy haczyk na ręczniki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

90. Czy Zamawiający dopuści szafki niewyposażone w tworzywowy uchwyt na szklankę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

91. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone są tworzywowymi wałkami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

92. Czy Zamawiający dopuści szafki składające się z jednej szuflady i jednego kontenera podzielonego na pół wyjmowaną półką zamykanego drzwiczkami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

93. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty szuflady i kontenera wykonane są ze stali węglowej pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

94. Czy Zamawiający dopuści szafki w których górna szuflada jest wyposażona w odejmowany, tworzywowy (polietylen) wkład dzielący szufladę na dwie części?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
95. Czy Zamawiający dopuści szafki, wyposażone w szufladę górną o wysokości 105mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
96. Czy Zamawiający dopuści szafki z dolny kontenerem zamykanym drzwiczkami z półką z płyty HPL dzielącą kontener na dwie części, półka z wcięciem na butelki stanowiącym uchwyt na butelki 1,5l, półka łatwo demontowana?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
97. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 820mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
98. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości 430mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
99. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm +/-10mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
100. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości przy rozłożonym blacie 1120mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
101. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm +/-10mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
102. Czy Zamawiający dopuści szafki ze sprężyną gazową nieosłoniętą aluminiową, prostokątną obudową?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
103. Czy Zamawiający dopuści szafki z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w metalowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
104. Czy Zamawiający dopuści szafki o regulacji blatu bocznego w zakresie 770 – 1080mm +/- 10mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

105. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których minimum dwie krawędzie blatu bocznego zabezpieczone są wałkami tworzywowymi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

106. Czy Zamawiający dopuszcza szafki z blatem bocznym wyposażonym w dwa koła zwiększające jego stabilność?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

107. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których możliwość wyboru kolorów blatów i frontów to 6 kolorów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

108. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485 na oferowane produkty? Oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez nich w/w certyfikatu, w związku z powyższym wymaganie go w specyfikacji technicznej SIWZ-u wpływa na ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5 łóżko szpitalne do rehabilitacji neurologicznej z przechyłami bocznymi wraz z szafkami przyłóżkowymi – 6 kpl.

109. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 104,4 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5,4 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

110. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 łóżko szpitalne do rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z szafkami przyłóżkowymi – 34 kpl

111. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

112. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

113. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżek szpitalnych o szerokości leża 850 mm. Parametr ten tylko nieznacznie, zaledwie o 20 mm odbiega od wymaganego w SIWZ (870 mm) i nie wpływa zasadniczo na funkcjonalność łóżka. Pozostałe parametry gabarytowe oferowanego łóżka – zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

114. Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem ok. 110 mm?

Rozwiązanie to w pełni umożliwi łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

115. Dotyczy pkt. 8: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia segmentu oparcia pleców w optyczny wskaźnik kąta przechyłu. Taki wskaźnik ma uzasadnienie w przypadku leża bez przechyłów Trendelenburga, a takiego nie dopuszcza dalsza część opisu przedmiotu zamówienia. Zastosowanie wskaźnika podnosi niepotrzebnie koszty łóżka.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

116. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowanie łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie już od 350 mm. Jest to parametr znacznie lepszy od wymaganego opisem przedmiotu zamówienia. Niższe położenie leża ułatwia pacjentom korzystanie z łóżka – szczególnie dotyczy to osób starszych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

117. Dotyczy pkt. 10: Chcemy zaoferować łóżko o szerszym zakresie zmiany wysokości leża, co przekłada się na dłuższy całkowity czas zmiany wysokości od minimalnej do maksymalnej. Dlatego prosimy o dopuszczenie dłuższego czasu zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej, tj. 30 sekund.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

118. Dotyczy pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżek z leżem wypełnionym sztywnymi, łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne płytami HPL. Płyty odcinane bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

119. Dotyczy pkt. 15: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania odcinanych szczytów w kształcie prostokąta otwartego, z zaokrąglonymi rogami górnymi, wykonanymi z profilu okrągłego (rurka), ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Oferowane szczyty wypełnione są płytą HPL 8 mm, są

sztynne, przez co nie wymagają i nie posiadają dodatkowych wzmocnień i uchwytów transportowych. Pozostałe parametry oferowanych szczytów – zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

120. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z kołami o średnicy 125 mm

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

121. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg

Odpowiedź:


Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

122. Dotyczy pkt. 35, 48: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty szuflad wykonane ze stali chromowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

123. Dotyczy pkt. 49: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej z blatem bocznym (14szt.) z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej ukrytej w kwadratowej aluminiowej osłonie, zwalnianej za pomocą wygodnego przycisku ze stali nierdzewnej, umieszczonego na wysokości blatu głównego szafki? Osłonę sprężyny oraz przycisk zwalniający, jakie znajdują się w oferowanym wyrobie pokazano na poniższej fotografii poglądowej wyrobu zbliżonego:

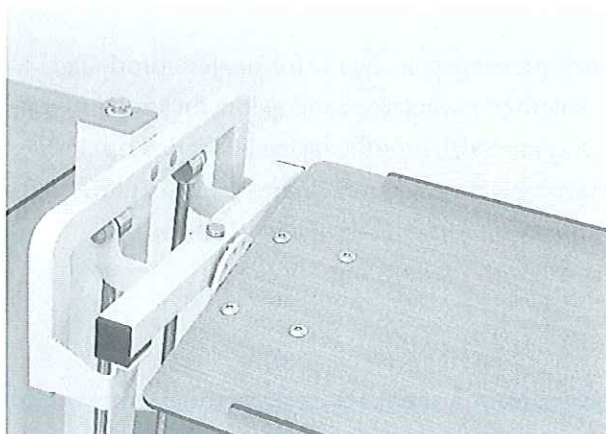

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

124. Dotyczy pkt. 51: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z blatem bocznym wykonanym z wytrzymałego, wodoodpornego tworzywa HPL, gładkiego z obu stron, bez dodatkowych wsporników, które byłyby w oferowanym rozwiązaniu zbędne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

125. Dotyczy pkt. 16. Z uwagi na fakt, iż opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje, czy wysokość

barierki bocznych ma stanowić całkowitą wysokość tychże barierki, czy wysokość liczoną od powierzchni leża, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści do zaferowania barierki boczne o wysokości co najmniej 390 mm liczonej od powierzchni leża do górnej krawędzi barierki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5 Łóżko szpitalne do rehabilitacji neurologicznej z przechyłami bocznymi wraz z szafkami przyłóżkowymi – 6 kpl.

126. Czy Zamawiający dopuści łóżko z układem elektrycznym spełniającym wymagania IP54?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

127. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża 125mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

128. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem pokrytym tworzywowymi osłonami, w którym w celu wykonanie zdjęcia kasetę wsuwa się pod materac lub pacjenta, zatem nie ma potrzeby stosowania tunelu na kasetę?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

129. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

130. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0- 60o oraz uda w zakresie 0-46o , a także pozycji anty-Trendelenburga 0-16o ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

131. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłów bocznych w zakresie 0-15o w obu kierunkach? Opisane w pkt 11 rozwiązanie jest charakterystyczne dla łóżka Sicuro Pesa firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

132. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwignią CPR umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie wyłącznie segmentu pleców? Opisane w pkt 15 rozwiązanie jest charakterystyczne dla łóżka Sicuro Pesa firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

133. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema krążkami jednoosiowymi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

134. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane proszkowo szyny do akcesoriów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

135. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami tworzywowymi, w tym 1 antystatyczne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

136. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem w każdej pozycji (w tym w przechyle bocznym) 200kg oraz 400kg w pozycji horyzontalnej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

137. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm? Opisane w pkt 29 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

138. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

139. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma metalowymi, lakierowanymi proszkowo relingami przy blacie głównym, dodatkowo wyposażoną w tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego zabezpieczające przedmioty pacjenta przed zsunieniem? Opisane w pkt 30 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

140. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym oraz bocznym wyposażonym w tworzywowe listwy na krawędziach? Opisane w pkt 30 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

141. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych? 17. Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 82mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

142. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ? Opisane w pkt 40 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stieglmeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

143. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: - szerokość szafki 510mm z blatem lub bez, - głębokość 485mm? Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

144. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

145. Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczonym w metalowej, lakierowanej manetce?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

146. Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Łóżko szpitalne do rehabilitacji ogólnoustrojowej wraz z szafkami przyłóżkowymi – 34 kpl.

147. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wolną przestrzenią pod podwoziem wynoszącą 160mm, za wyjątkiem miejsca mocowania siłowników – skrajna lokalizacja – rozwiązanie nie mające wpływu na współpracę łóżka z podnośnikami pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

148. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 35°?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

149. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

150. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją z minimalnej do maksymalnej wysokości w czasie około 30 sekund?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza czas do 30 sekund.

151. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością selektywnego zablokowania funkcji, w tym pozycji Trendelenburga oraz zablokowania wszystkich funkcji, za wyjątkiem funkcji CPR?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

152. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwignią CPR umieszczoną bezpośrednio przy segmencie pleców?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

153. 7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

154. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odedjmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

155. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery dzielone, składane i opuszczane do boku leża oraz odchylane, niezależnie barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości od szczytu głowy do szczytu nóg o wysokości 45 cm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

156. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema metalowymi barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża, składane wzdłuż leża oraz odchylane, wyposażone w przyciski zwalniające blokadę opuszczenia umieszczone w górnej poprzeczce, co w znaczący sposób ułatwia pracę personelowi?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

157. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm z centralną i kierunkową blokadą kół ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

158. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami tworzywowymi, w tym 1 antystatyczne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

159. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów spośród 10 propozycji oraz z ramą w kolorze białym RAL 9002?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

160. Czy w pkt 28 (II. Szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego) Zamawiający dopuści możliwość zaferowania szafki wyposażonej w blat boczny, który po złożeniu nie wystaje poza obrys zewnętrzny korpusu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

161. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm? Opisane w pkt 42 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stiegemeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

162. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

163. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma metalowymi, lakierowanymi proszkowo relingami przy blacie głównym, dodatkowo wyposażoną w tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego zabezpieczające przedmioty pacjenta przed zsunięciem? Opisane w pkt 43 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stiegemeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

164. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym oraz bocznym wyposażonym w tworzywowe listwy na krawędziach? Opisane w pkt 43 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stiegemeyer.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

165. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

166. Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 82mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

167. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ? Opisane w pkt 53 rozwiązanie jest charakterystyczne dla szafki Soreno Eco firmy Stiegemeyer.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

168. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: - szerokość szafki 510mm z blatem lub bez, - głębokość 485mm? Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

169. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

170. Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczonym w metalowej, lakierowanej manetce?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

171. Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska

