

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Tarnowskie Góry, dnia 24.06.2022r.

AZ.272.4.10.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

zapytania I

dotyczy: Część B

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie czy Zamawiający zgodnie z zapisem w części B – oczekuje Inkubatora Otwartego czy też doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający planuje zakupić Respirator noworodkowy, zgodnie ze specyfikacją parametrów zawartą w Załączniku nr 2? W przypadku omyłki prosimy o modyfikację zapisu w części B.

Odp. Zamawiający oczekuje Inkubatora otwartego ze stanowiskiem do resuscytacji.

dotyczy: Część B Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

2. **§5 ust. 5** Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl



NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

3. **§5 ust. 9** Uprzejmie proszę o zmianę zapisu na „Wykonawca gwarantuje, iż po trzech naprawach tego samego elementu/podzespołu sprzętu medycznego nastąpi wymiana na nowy element/podzespół”, co będzie zgodne z zaleceniami producenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust. 9.

4. **§8 ust. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych i potwierdzenie, że kary umowne odnoszą się do wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy a nie wartości umowy:

- pkt. 1) do 10%?

- pkt. 3) do 0,2%?

W przypadku braku zgody na odniesienie kar umownych do wartości każdego ze sprzętów z osobna uprzejmie proszę o potwierdzenie, że na każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §8 ust. 1. Zamawiający potwierdza, że na każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.

5. **§8 ust. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalona wysokość kar umownych jest wysoka, nie proporcjonalna do wartości zamówienia, odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §8 ust. 2.

zapytania II

Dotyczy: Załącznik nr 2

1. **pkt. 1, 3.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania wózka do transferu blatu, najazd na kolumnę z dwóch stron - od strony głowy lub nóg pacjenta. Rozwiązanie takie jest równie funkcjonalne jak opisane w OPZ a różnica wynika jedynie z technologii danego producenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza najazdu na kolumnę od strony głowy lub nóg ze względu na rozmiary Sali.

2. **pkt. 1, 3.** Prosimy o zastosowanie oceny i przyznanie 10 punktów za zaoferowanie pilota bezprzewodowego który może być ładowany za pomocą ładowarki zewnętrznej oraz za pomocą dedykowanego przewodu dostarczanego w ramach dostawy do kolumny stoły operacyjnego. Rozwiązanie takie zwiększa elastyczność obsługi stołu.

Odp. Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ.

3. **pkt. 2.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym kolumna w najwyższym miejscu (przy samej kolumnie) ma wymiar 36mm. Różnica ta jest zatem praktycznie niezauważalna, a co więcej dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu samej podstawy jest możliwe postawienie na niej nóg, co zapewnia możliwość jak najbardziej ergonomicznej pracy operatora.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

4. **pkt. 4.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym dolna pozycja regulacji wysokości (bez materacy) wynosi 621mm. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. **pkt. 6.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja przechyłów bocznych wykonywana jest w zakresie 280/280. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

6. **pkt. 7.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja pozycji Trendelenburga wynosi 450. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. Jednocześnie prosimy o usunięcie punktacji tego parametru gdyż od poziomu 450 parametr ten nie wpływa na wartości kliniczne urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. **pkt. 8.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym regulacja pozycji anty-Trendelenburga wynosi 450. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna w warunkach klinicznych i nie wpływa w niekorzystny sposób na funkcjonalność urządzenia. Jednocześnie prosimy o usunięcie punktacji tego parametru gdyż od poziomu 450 parametr ten nie wpływa na wartości kliniczne urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. **pkt. 9.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym panel wbudowany jest w kolumnę stołu na boku po prawej stronie pacjenta. Takie rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne a dostęp do panelu łatwiejszy niż w przypadku panelu zamontowanego od strony głowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. **pkt. 9.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu w którym panel wskazuje m.in. aktualny stan naładowania akumulatorów, a parametry takie jak pozycja blatu, typ blatu i aktualnie wykonywane ruchy, informacje o ewentualnych usterkach systemu – wszystkie informacje w języku polskim – wyświetlane są na ekranie pilota sterującego – który jest podstawowym urządzeniem sterującym stołu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. **pkt. 12.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu który posiada możliwość awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami kolumny stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu od lewej lub prawej strony głowy pacjenta w celu zapewnienia wygodnego dostępu do niego z obu stron stołu i uniknięcia przypadkowych ruchów spowodowanych niezamierzoną aktywacją.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. **pkt. 13.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z panelem sterującym wyposażonym m.in. w przycisk samopoziomujący (przycisk „0”), przycisk aktywujący pozycję do czyszczenia (maksymalnie rozciągnięte osłony kolumny), przyciski sterowania wysokością kolumny, przechyłów bocznych i wzdłużnych stołu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. **pkt. 14.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z kolumną stołu wyposażoną w następujące systemy oprogramowania:
- system oprogramowania pozwalający na automatyczne rozpoznanie, bez naciskania żadnego przycisku, położenia blatu na kolumnie i ustawień kątów ruchów;
 - system oprogramowania rozpoznający akcesoria i segmenty blatu i pozwalający na uniknięcie wypadków w przypadku nieprawidłowego ustawienia.
 - system antykolizyjny blatu

Wszystkie wyżej wymienione systemy ze względów bezpieczeństwa są aktywne non-stop – niewymagające aktywacji dedykowanym przyciskiem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. **pkt. 15.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego posiadający system sterowania awaryjnego niewymagający zastosowania dodatkowych akumulatorów. Stół jest też wyposażony w tryb czuwania w który przechodzi po dłuższym czasie braku ruchów.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. **pkt. 18.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym blat wyposażony jest w matracę przeciwoślizgową o grubości 80 mm, antystatyczne, bezszwowe, odporne na środki dezynfekcyjne, mocowane na rzep. Takie rozwiązanie nie wpływa niekorzystnie na aspekty funkcjonalne urządzenia a różnica wynika jedynie z technologii danego producenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. **pkt. 20.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym elektromechaniczna regulacja podnóżków - dwóch jednocześnie lub pojedynczo mieści się w zakresie: góra +900, dół -1100. Zakres taki jest większy niż wymagany w OPZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. **pkt. 21.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z elektromechaniczną regulacją przesuwu wzdłużnego blatu 400mm. W przypadku konstrukcji naszego stołu jest to wartość pozwalająca na dostęp aparatu RTG na bardzo dużej długości, a to jest parametrem istotnym z klinicznego punktu widzenia. Jednocześnie prosimy o usunięcie punktacji tego parametru, gdyż jak wspomniano powyżej – jest to jedynie parametr techniczny, a nie parametr wpływający bezpośrednio na funkcjonalność urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. **pkt. 23.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego bez regulacji oparcia pleców sterowanej mechanicznie (oparcie pleców górne od strony podglówka)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. **pkt. 23.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym regulacja oparcia pleców sterowana jest elektromechanicznie (oparcie pleców górne od strony podglówka) w zakresie: góra +900, dół -900. W przypadku dopuszczenia zaoferowania tego rozwiązania, prosimy o dopuszczenie blatu z płytą dolną zamontowaną na stałe.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. **pkt. 27.** Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego, który osiąga przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga 300 przy jednoczesnym przechyle bocznym – 200. Rozwiązanie takie jest sprawdzone od wielu lat w warunkach klinicznych i wykorzystywane np. w przypadku operacji laparoskopowych.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że osiągnięcie wymogu stawianego przez Zamawiającego, ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe bez zastosowania akcesoriów m.in. takich jak podpory barków czy podpory pod stopy – których dostarczenia Zamawiający nie przewiduje do żadnego ze stołów.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

zapytania III

dotyczy: Część A - Stoły operacyjne z systemem wymiennych blatów: 3 kolumny, 7 blatów, 6 wózków do transportu blatów – 4 szt.


1. Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę i będzie wymagał do zaoferowania: Stoły operacyjne z systemem wymiennych blatów składające się z: kolumny/ podstawy – 3 szt., wymienne blaty – 7 szt., wózki do transportu blatów – 6 szt. zgodnie z Tabelą 1- Specyfikacja parametrów?

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i wymaga: Stoły operacyjne z systemem wymiennych blatów składające się z: kolumny/ podstawy – 3 szt., wymienne blaty – 7 szt., wózki do transportu blatów – 6 szt.

dotyczy: Część C – Stacja przeglądowa na salę operacyjną – 4 szt.

1. Czy zabudowy ścian sal operacyjnych zawierają otwory oraz podkonstrukcję do zainstalowania stacji przeglądowych, jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów, jeśli nie to prosimy o podanie informacji, czy oferent ma we własnym zakresie wykonać otwory oraz podkonstrukcję do zamontowania stacji?

Odp. Na każdej sali operacyjnej przygotowany jest panel o wymiarach 1190x1100 mm, w którym Wykonawca robót budowlanych dokona wycięcia otworu pod stację przeglądową, zgodnie z wytycznymi Dostawcy. Podkonstrukcja wraz z jej montażem, dodatkowe zaczepy oraz uszczelnienie po stronie Dostawcy stacji.

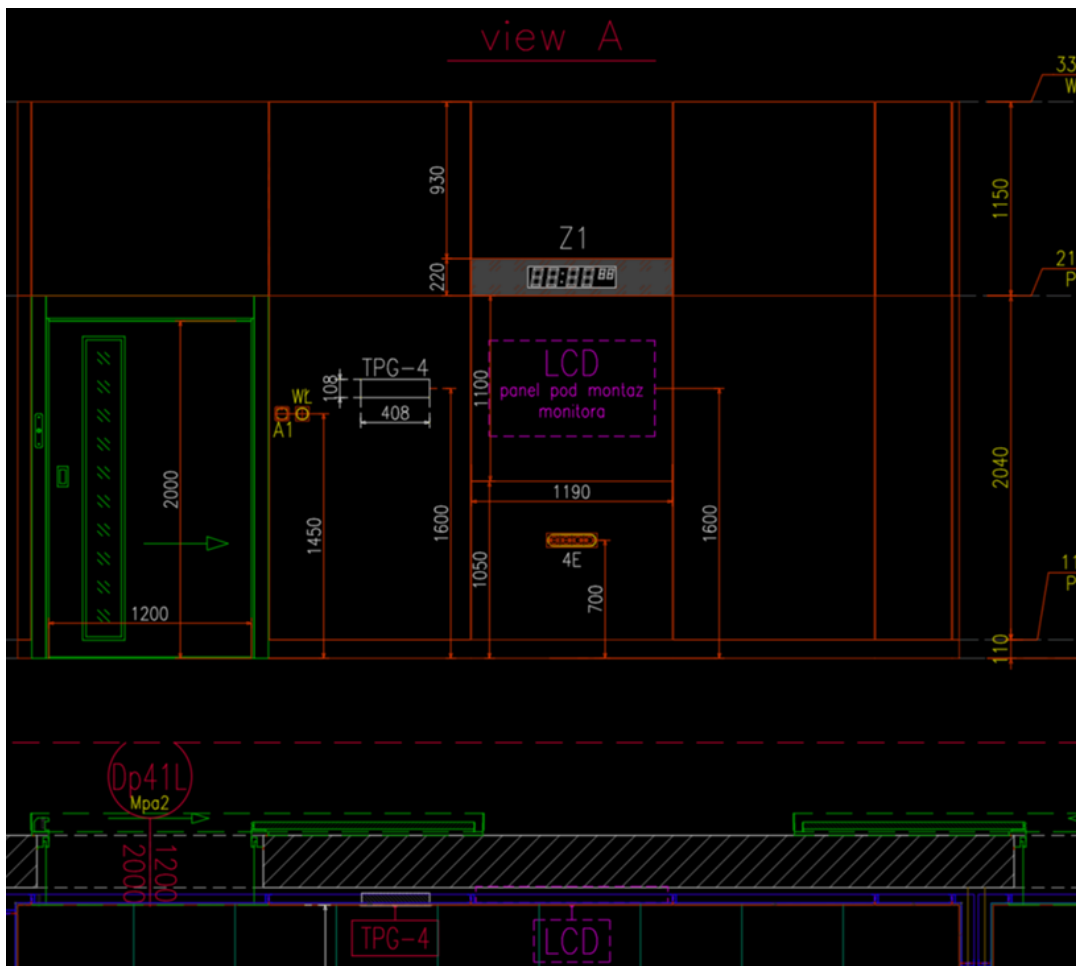

2. Czy Zamawiający posiada wykupione licencje programów: PACS, RIS, HIS, jeśli tak to prosimy o podanie nazwy firmy, która jest dostawcą licencji, jeśli nie to czy oferent ma je dostarczyć wraz ze stacjami przeglądowymi?

Odp. Zamawiający posiada licencje PACS i RIS (firmy Alteris), HIS (firmy Asseco)

3. Czy w miejsce montażu stacji przeglądowych doprowadzone są instalacje elektryczne, jeśli tak to prosimy o ich podanie?

Odp. W każdej sali operacyjnej jako zasilanie zamontowane są gniazda podwójne 230V, a dla LAN jest doprowadzony przewód F/FTP zakończony gniazdem RJ45.

4. W celu instalacji stacji przeglądowych o przekątnej ekranu min. 40" wymagana jest odległość od zabudowy ścian Sali operacyjnej do ściany min.14 cm – czy jest ona zachowana?

Odp. W zależności od sali operacyjnej odległość od zabudowy do ściany wynosi ok. 6 - 8 cm. Dostawca we własnym zakresie zobowiązany jest przed montażem stacji przeglądowych dokonać wykucia w ścianach stosowanych otworów umożliwiającą zabudowę stacji przeglądowych. Przed wykonaniem tych prac Dostawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie elementy mogące ulec zniszczeniu w trakcie realizacji prac oraz usunąć gruz z wykucia.

Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, przedłużam termin składania i otwarcia ofert oraz zmieniam okres związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

- 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11.10.2022 roku, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.**

II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

- 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14 lipca 2022 roku do godz. 11:00.****

III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

- 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 14 lipca 2022 roku, o godz. 11:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.**

Jednocześnie działając na podstawie art. 137, ust. 1 i ust. 2 ustawy **zmieniam treść SWZ - w załączniku nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozporządzenia sankcyjnego) tytuł postępowania otrzymuje brzmienie: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2”.**

W załączeniu nowy załącznik nr 5 do SWZ.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu