



Gostyń, dnia 14.01.2025 r.

Dotyczy postępowania pn: **Dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitalnej SPZOZ w Gostyniu.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/21/2024**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 w poz. 1 siatki chirurgiczne, przepuklinowe, niebarwione, monofilamentowe, niewchłaniające, polipropylenowe o parametrach:

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga parametrów siatki opisanych w SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1 i 2

Proszę o podanie numerów referencyjnych aktualnie używanych adapterów lub doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga adapterów do następujących posiadanych przez siebie wyrobów medycznych:

Pozycja nr 1 - IntelliVue MX450

Pozycja nr 2 - BSM-3763

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 1 siatki polipropylenowe o gramaturze 48g/m² ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga gramatury opisanej w SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 1 siatki polipropylenowe o gramaturze 127g/m² ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga gramatury opisanej w SWZ.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 37

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 37 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- średnica 11 FR - długość 15 cm, 15,5 cm, 20 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewnika opisanego w pytaniu i wymaga wyrobu medycznego opisanego w SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 37

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogów co do tego parametru.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 poz. 37 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 2 pozycji nr 37 i nie utworzy oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 8

Dotyczy projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 5:

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości netto niezrealizowanej Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10, w punkcie 1, trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 5 mm z kaniulą karbowaną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10, w punkcie 1, trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 5 mm z kaniulą karbowaną.



Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10, w punkcie 2, trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 10 mm z kaniulą karbowaną, długości 10cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 10, w punkcie 2, trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 10 mm z kaniulą karbowaną, długości 10cm.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 5mm, długość 10 cm; urządzenie ochronne mogące się wysunąć w celu ochrony narządów jamy brzusznej zestaw z dodatkową kaniulą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 11mm, długość 11 cm; urządzenie ochronne mogące się wysunąć w celu ochrony narządów jamy brzusznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Sterylna, syntetyczna, monofilamentowa siatka polipropylenowa, zbudowana z niewchłaniających włókien polipropylenu; przeznaczona do wzmocnienia tkanki. Gramatura 60 +-85 g/m² ; Grubość 0,45 mm ± 0,05 mm; Wielkość porów min. 0,5 mm²; Grubość nici 0,16 mm; rozmiar 15cm x 15 cm; opakowanie a 1 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie: Sterylna, syntetyczna, monofilamentowa siatka polipropylenowa, zbudowana z niewchłaniających włókien polipropylenu; przeznaczona do wzmocnienia tkanki. Gramatura 60 +-85 g/m² ; Grubość 0,45 mm ± 0,05 mm; Wielkość porów min. 0,5 mm²; Grubość nici 0,16 mm; rozmiar 15cm x 15 cm; opakowanie a 1 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia formularza asortymentowo-cenowego według którego wzoru – czy zgodnie z tabelą w pliku o nazwie OPZ - pakiety.xls czy zgodnie z tabelą „Część Formularza oferty – Formularz cenowy Wzór formularza oferty cd.” w pliku SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający wymaga złożenia Formularza ofertowego zgodnie z obowiązującym wzorem, którego treść musi odpowiadać określonym w SWZ wymogom. Należy wskazać, że Zamawiający oczekuje wyraźnego wskazania nr Pakietu, na który składa Wykonawca ofertę oraz zgodności przedmiotu zamówienia z OPZ wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy zostało dodane wyrażenie „,chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 16

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie jedynie oryginału faktury bez dodatkowej kopii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 19

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 19: Wchłaniający materiał hemostatyczny z utlenionej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny; wata lub gaza wełniana – zapewnia użycie jedynie niezbędnej ilości oraz pozwala na umiejscowienie na wszystkich typach powierzchni, włączając obszary z utrudnionym dostępem; 5cm x 7 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem przedstawionych parametrów.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 9 testy konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza butelkę 200ml w pakiecie nr 1 pozycja nr 1.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik w rozmiarze 5 w pakiecie nr 1 pozycja nr 5.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17-19

Czy Zamawiający dopuści cewniki do tlenu ze śladowymi ilościami ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik ze śladowymi ilościami ftalanów w pakiecie nr 1 pozycja nr 19 oraz nie dopuszcza cewników ze śladowymi ilościami ftalanów w pakiecie nr 1 pozycja nr 17 i 18.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 74

Czy Zamawiający dopuści kaczki damskie plastikowe?



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaczki damskie plastikowe w pakiecie nr 1 pozycja nr 74.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 81

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'300 sztuk z przeliczeniem ilości w pakiecie nr 1 pozycja nr 81.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi spełniający poniższy opis:

Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym,

Szczelne połączenie z butelką z płynem lub workiem z krwią

Elastyczna duża komora kroplowa – o długości 10 cm

Miękki elastyczny dren o długości 150 cm

Cały bez zawartości ftalanów (łącznie z pompką)

Możliwość sterowania prędkością przepływu (zacisk przesuwalny – pionowy, rolkowy)

Szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną łącznikiem Luer - Lock

Odpowiedź: Pozycja nr 92 w pakiecie nr 1 nie zawiera przyrządu do szybkiego przetaczania krwi. Zamawiający dopuszcza przyrząd do szybkiego przetaczania krwi spełniający podany w pytaniu opis w pakiecie nr 1, lecz w pozycji nr 94.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 131

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do TBC ze skalą co 0,01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki do TBC ze skalą co 0,01 pakiecie nr 1 pozycja nr 131.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 135

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra w rozmiarach: 12, 15, 18, 21, 24? Pytanie uzasadniamy tym, iż obecnie nie ma na rynku dostępnych drenów w rozmiarach wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny Kehra w rozmiarach: 12, 15, 18, 21, 24 w pakiecie nr 1 pozycja nr 135.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 136

Czy Zamawiający dopuści cewniki wyłącznie w rozmiarach 12-30? (co 2)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki wyłącznie w rozmiarach 12-30? (co 2) w pakiecie nr 1 pozycja nr 136.

Pytanie nr 28

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 134

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80x170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradło o wymiarach 80x170 cm pakiecie nr 1 pozycja nr 134.

Pytanie nr 29

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 137

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poj. 6 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza nebulizatora o pojemności 6 ml pakiecie nr 1 pozycja nr 137.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 30

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 138-139

Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza woreczki w opakowaniu foliowym w pakiecie nr 1 pozycje nr 138 i 139.

Pytanie nr 31

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 142

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena bez przewodnicy, o długości 105 cm, trójdrożną, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sondę Sengstakena bez przewodnicy, o długości 105 cm, trójdrożną, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów w pakiecie nr 1 pozycja nr 142.

Pytanie nr 32

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 155

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie wzierniki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby wszystkie wzierniki pochodziły od jednego producenta w pakiecie nr 1 poz. 155.

Pytanie nr 33

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 157

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 15x244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza osłonę o wymiarach 15x244 cm w pakiecie nr 1 pozycja nr 157.

Pytanie nr 34

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 163

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 0,6x19 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę o wymiarach 0,6x19 mm w pakiecie nr 1 pozycja nr 163.

Pytanie nr 35

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 165

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości? Koreczki w opakowaniu zbiorowym są również pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości w pakiecie nr 1 pozycja nr 165.

Pytanie nr 36

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wodę o pojemności 500 ml z przeliczeniem na 27 opakowań?



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wody o pojemności 500 ml z przeliczeniem na 27 opakowań w pakiecie nr 3 pozycja nr 5.

Pytanie nr 37

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby jeden pojemnik nadawał się dla wielu pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu, aby jeden pojemnik nadawał się dla wielu pacjentów w pakiecie nr 3 pozycja nr 5.

Pytanie nr 38

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści poj. 25 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemności 25ml w pakiecie nr 3 pozycja nr 6.

Pytanie nr 39

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 18 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o przepływie 18 ml/min w pakiecie nr 6 pozycja nr 2.

Pytanie nr 40

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 10 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o przepływie 10 ml/min w pakiecie nr 6 pozycja nr 3.

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 21 ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę o przepływie 21 ml/min w pakiecie nr 6 pozycja nr 3.

Pytanie nr 42

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'8 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opakowania a 8 sztuk w pakiecie nr 7 pozycja nr 10.

Pytanie nr 43

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'4 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opakowania a 4 sztuk w pakiecie nr 7 pozycja nr 10.

Pytanie nr 44

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'5 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości w pakiecie nr 7 pozycja nr 12.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 85 g/m², grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,0 x 1,2 mm, grubość nici 0,15 mm, pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę o gramaturze 85 g/m², grubość 0,55 mm, wielkość porów 1,0 x 1,2 mm, grubość nici 0,15 mm.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200 ml.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon mikrobiologicznie czystą posiadającą Świadectwo Czystości Mikrobiologicznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wyrobu medycznego sterylnego.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze o następujących parametrach:

- trójpłaszczyznowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji *przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po docisnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)*
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje vibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
 - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
 - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn



Odpowiedź: Zamawiający w pozycjach 3 i 4 w pakiecie nr 1 wymaga dwóch odrębnych nakłuwaczy w różnych rozmiarach. Oferent w pytaniu nie precyzuje jaki rozmiar chce zaoferować w konkretnej pozycji, stąd Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nakłuwaczy o podanym w pytaniu opisie.



Pytanie nr 49

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza nakłuwaczy pakowanych po 100 sztuk w pozycjach nr 3 i 4.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar cewnika CH6 zamiast CH5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar cewnika CH6 zamiast CH5.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z medycznego PCV zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik ze śladowymi ilościami ftalanów w pakiecie nr 1 pozycja nr 19 oraz nie dopuszcza cewników ze śladowymi ilościami ftalanów w pakiecie nr 1 pozycja nr 17 i 18.

Pytanie nr 52

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik dla noworodków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cewnik dla noworodków w pozycji nr 17 pakiet nr 1.

Pytanie nr 53

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza cewnika w rozmiarze dla dzieci w pozycji nr 17.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 16-19

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 55

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści igły tępe ścięte pod kątem 40st z otworem centralnym, w rozmiarze 1,2mm x 40mm, pakowana a'100 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza igły tępe ścięte pod kątem 40st z otworem centralnym, w rozmiarze 1,2mm x 40mm, pakowana a'100 sztuk.

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści igły quinke?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje igieł typu Pencil Point.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 57

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści igły 27G, długość 120mm pencil point?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje igieł w rozmiarze 26G.

Pytanie nr 58

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści igły 24G, długość 120mm pencil point?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje igieł w rozmiarze 26G.

Pytanie nr 59

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 53-56

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 20 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 60

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści introduktor z zastawką w rozmiarze 5F zamiast 4F?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje introduktora w rozmiarze 4F.

Pytanie nr 61

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym średnica 24G (0,7mm)x długość 19mm; cienki cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, ze standardową końcówką luer-lock, z silikonową zastawką zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, port boczny kodowany kolorem, wyposażona w zwykły korek portu bocznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanej w pytaniu kaniuli w pozycji nr 62.

Pytanie nr 62

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym średnica 24G (0,7mm)x długość 19mm; cienki cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG, ze standardową końcówką luer-lock, z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia (pełniący rolę zastawki), port boczny kodowany kolorem, wyposażona w samodomykający się korek portu bocznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanej w pytaniu kaniuli w pozycji nr 62.

Pytanie nr 63

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=1szt czy op=100szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 200 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 64

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 63-68

Czy Zamawiający dopuści katetery pakowane lekko zwinięte?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kateterów pakowanych lekko zwiniętych.

Pytanie nr 65

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 72

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. i wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem liczby opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kieliszki pakowane a'90 szt. i wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 66

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 73-74

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=1szt? ? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 20 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 67

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 74

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną męską?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaczki sanitarnej męskiej w pozycji nr 74 pakiet nr 1.

Pytanie nr 68

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 75

Czy Zamawiający dopuści łącznik z kontrolą siły ssania, sterylny kompatybilny z drenami o średnicach od CH4 do CH18?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik z kontrolą siły ssania, sterylny kompatybilny z drenami o średnicach od CH4 do CH18.

Pytanie nr 69

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 75

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=1szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 50 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 70

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 76

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów dwustronny; średnica 10mm oraz 8,5mm, długość 68mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łącznik do drenów dwustronny; średnica 10mm oraz 8,5mm, długość 68mm.



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 71

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 76

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt czy op.a'100 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 100 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 72

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 77-80

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań maksymalnie a 100 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 73

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 77-80

Czy Zamawiający dopuści łączniki schodkowe do drenów proste odpowiednio:

oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]
1	6	5
2	8	6
3	10	9
4	12	10

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łączniki wymienione w pytaniu.

Pytanie nr 74

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 81

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 75

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 82

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 76

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 84 i 86

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek w jednym rozmiarze dedykowanym dla dorosłych i dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by zaoferować opaski odpowiednio: w pozycji nr 84 przeznaczone do stosowania u dorosłych i w pozycji nr 86 przeznaczone do stosowania u dzieci.



Pytanie nr 77

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 88-91

Czy Zamawiający oczekuje igieł typu motylek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje igieł typu motylek.

Pytanie nr 78

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 88-91

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op.a'1szt. czy op.a'50 szt.? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 79

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym, ostrym kolcem, z komorą o długości 60mm (55mm w części przeźroczystej) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dwukanałowym, czteropłaszczyznowym, ostrym kolcem, z komorą o długości 60mm (55mm w części przeźroczystej).

Pytanie nr 80

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości min. 150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości min. 150cm.

Pytanie nr 81

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 82

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 93

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający wszelkie wymagania dotyczące wyrobu medycznego zawarł w SWZ.

Pytanie nr 83

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 93

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający wszelkie wymagania dotyczące wyrobu medycznego zawarł w SWZ.



Pytanie nr 84

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 92-94


Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 85

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 94

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania firmy GALMED w całości wolny od ftalanów o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu (aktualnie jedyny produkt do szybkiego przetaczania dostępny na rynku)

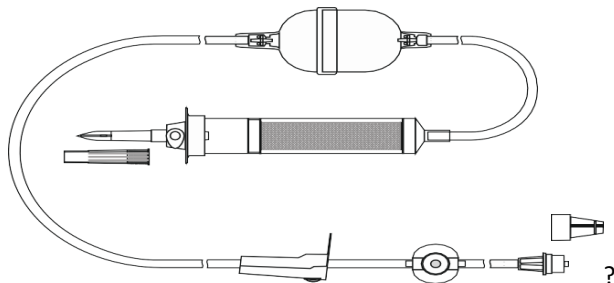

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowany w pytaniu wyrób medyczny. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 86

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 95-96

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 87

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 107-112

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających nie więcej niż wymagana liczba sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 88

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 113-115

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 100 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.



Pytanie nr 89

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 116-124

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 90

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 125

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH14 z balonem 5ml, reszta rozmiarów i parametrów zgodnie z swz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgłębnik w rozmiarze CH14 z balonem 5ml, reszta rozmiarów i parametrów zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 126

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw sterylny.

Pytanie nr 92

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 125-127

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający określił w pozycji nr 125, że wymaga opakowań a 2 sztuki z możliwością zaoferowania opakowań a 1 sztuka, w pozycjach 126 i 127 wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka.

Pytanie nr 93

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 129

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 94

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 131

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dokładniejszą skalą co 0,01ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki z dokładniejszą skalą co 0,01ml.

Pytanie nr 95

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 132, 133, 135-137

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt?. Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 96

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 132

Czy Zamawiający dopuści pasy wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza pasów wielorazowego użytku.



C E R T Y F I K A T PN-EN ISO 9001:2015-10

Pytanie nr 97

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 134

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej.

Pytanie nr 98

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 134

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 99

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 135

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów w rozmiarach CH12 do CH24 co 2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów w rozmiarach CH12 do CH24 co 2.

Pytanie nr 100

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 137

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem, rurką karbowaną i drenem, elementy z medycznego tworzywa sztucznego m.in. PVC?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu wyrobu medycznego.

Pytanie nr 101

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 138-139

Czy Zamawiający dopuści woreczki z samoprzylepną częścią pokrytą antyalergicznym klejem, w opakowaniach foliowych? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza woreczki z samoprzylepną częścią pokrytą antyalergicznym klejem, w opakowaniach foliowych.

Pytanie nr 102

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 140

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, z otworem centralnym i 6 otworami bocznymi, z nierozszerzanym końcem dystalnym Występujący w rozmiarach: 18,20,21,24,26,27,30,33?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dren brzuszny silikonowy, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, z otworem centralnym i 6 otworami bocznymi, z nierozszerzanym końcem dystalnym występujący w rozmiarach: 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33.

Pytanie nr 103

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 140

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 104

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 142

Czy Zamawiający dopuści jałowy ustnik uniwersalny w rozmiarze 20x26mm?



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Odpowiedź: W pozycji nr 142 Zamawiający wymaga zaoferowania sondy Sengstakena.

Pytanie nr 105

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 142

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond w rozmiarach: 16, 18 i 20F?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sond w rozmiarach: 16, 18 i 20F.

Pytanie nr 106

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 142-143

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających inną liczbę sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 107

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 145

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 108

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 148

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt czy a'100 szt.?. Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 100 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 109

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 160

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 10 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 110

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 163

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,6 x19mm 26G? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kaniulę 0,6 x 19mm 26G.

Pytanie nr 111

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 164

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 2,0 x45mm 14G? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaniuli 2,0 x 45 14G.



Pytanie nr 112

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 163-164

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 100 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 113

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 165

Czy Zamawiający wymaga podania ceny za op=a'1szt? Jednostką miary są opakowania. Czy w przypadku oferowanego innego opakowania Zamawiający zgadza się na przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opakowań a 1 sztuka. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających maksymalnie 1000 sztuk z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 114

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 115

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 116

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 117

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych.

Pytanie nr 118

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów do przetaczania za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 119

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej.

Pytanie nr 120

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki 20ml pakowane a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 121

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie) zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

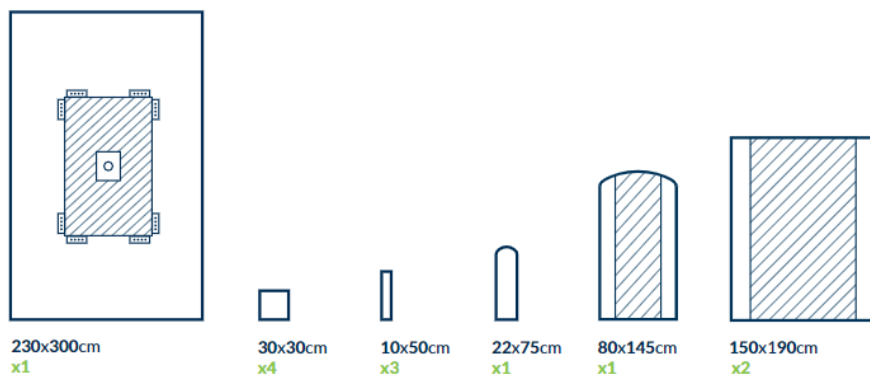

Zestaw pakowany a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zestawów pakowanych a 7 sztuk.

Pytanie nr 122

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 12

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego w formie taśmy; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem. włóknina zawierająca: alginian wapnia o dużej zawartości kwasu gulurowego, karboksymetylocelulozę (CMC) i kompleks srebra jonowego (fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy) - który uwalnia jony srebra w obecności wysięku z rany. Opatrunek w rozmiarze 3x44cm?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga opatrunku opisanego w SWZ.

Pytanie nr 123

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 13

Czy w miejsce opisanego opatrunku Zamawiający dopuści opatrunek o poniższym opisie?

Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnąć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga opatrunku opisanego w SWZ.

Pytanie nr 124

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm.

Pytanie nr 125

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 i 5

Mam pytanie co do pakietu nr 7 czy w pozycjach 4 i 5 jest ten sam produkt czy doszło do omyłki pisarskiej?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga produktu o barwie bursztynowej.

Pytanie nr 126

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 poz. 2 jednorazowego zestawu trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 11 mm, długość 10 cm; ; z ostrzem tnącym liniowym, bezpiecznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 127

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 poz. 1 jednorazowego zestawu trokarów laparoskopowych do przepuklin; średnica 5 mm, długość 10 cm; ; z ostrzem tnącym liniowym, bezpiecznym + dodatkowa kaniula 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 128

Dotyczy Pakietu nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 sterylnej, syntetycznej, monofilamentowej siatki polipropylenowej, zbudowanej z niewchłaniających włókien polipropylenu; przeznaczonej do wzmocnienia tkanki. Gramatura 60 g/m²; Grubość 0,55; Wielkość porów 1,05 mm x 1,10 mm; Grubość nici 0,15 mm; rozmiar 15cm x 15 cm; opakowanie a 5 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobu medycznego opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 129

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki dooskrzelowej w rozmiarze 28Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurki dooskrzelowej w rozmiarze 28Fr pod warunkiem zaoferowania w pozycjach nr 2 i 4 rurki o rozmiarze 32 FR.



Pytanie nr 130

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki dooskrzelowej w rozmiarze 32Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurki dooskrzelowej w rozmiarze 32Fr pod warunkiem zaoferowania w pozycjach nr 1 i 3 rurki o rozmiarze 28 FR.

Pytanie nr 131

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli adaptery czujnika CO2 do kardiomonitora Nihon Kohden do osobnego pakietu bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na tą pozycję?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do osobnego pakietu i nie wyraża zgody na zaoferowanie wyłącznie tej pozycji.

Pytanie nr 132

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Zgodnie z art. 99 ustawy Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił informacji czy oczekuje jednorazowego adaptera dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym kompatybilnego z czujnikiem CO2 TG-900P, przeznaczonego dla dzieci i dorosłych (>10 kg), posiadającego warstwę zabezpieczającą przed osadzaniem się wody zakłócającym pomiar, przestrzeń martwa: max 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, ale zezwala na zaoferowanie tego wyrobu medycznego.

Pytanie nr 133

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu w oryginalnych opakowaniach zbiorczych zawierających 50 Szt. adapterów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie asortymentu w oryginalnych opakowaniach zbiorczych zawierających 50 szt. adapterów.

Pytanie nr 134

Dotyczy projektu umowy §3 ust. 2 (dla pakietu nr 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych w pakiecie nr 11.